Pile Dynamics Inc
Transducer 227I

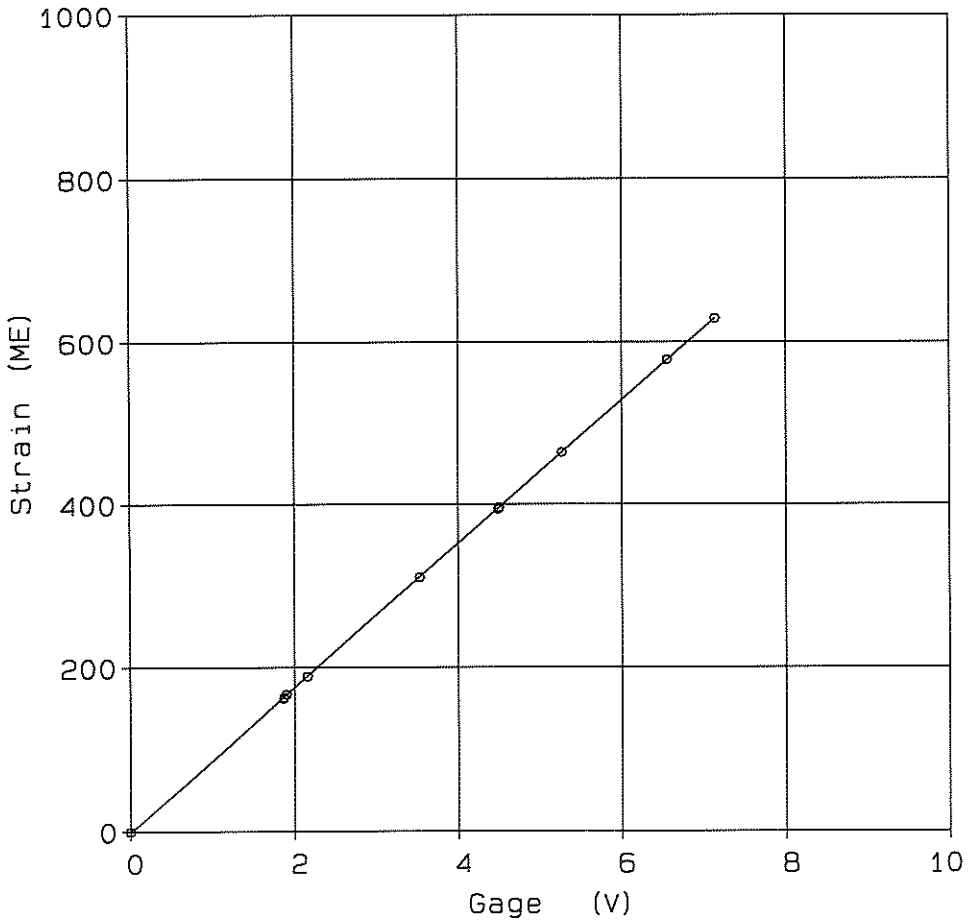

PDA Cal Factor	=	88.4 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	306.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
168	1.91
163	1.88
163	1.87
190	2.16
311	3.53
396	4.50
394	4.49
464	5.27
579	6.57
630	7.14

Calibrated by: J. Rantelaff

Calibrated on: 27-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2