Pile Dynamics, Inc.
Transducer 227W

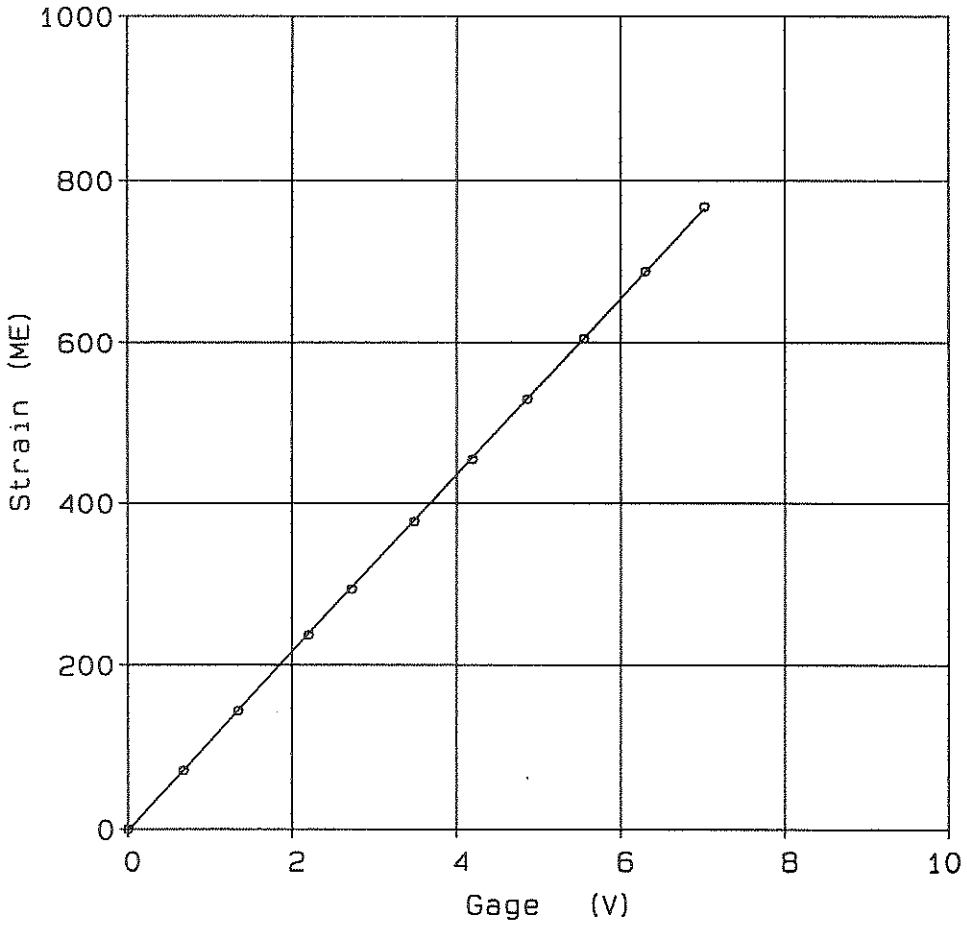

PDA Cal Factor = 109.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 380.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
72	.68
144	1.35
237	2.20
294	2.72
377	3.48
455	4.20
530	4.87
606	5.56
688	6.30
769	7.02

Calibrated by: Jim Stubchaff

Calibrated on: 01-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2