Pile Dynamics Inc
Transducer 228I

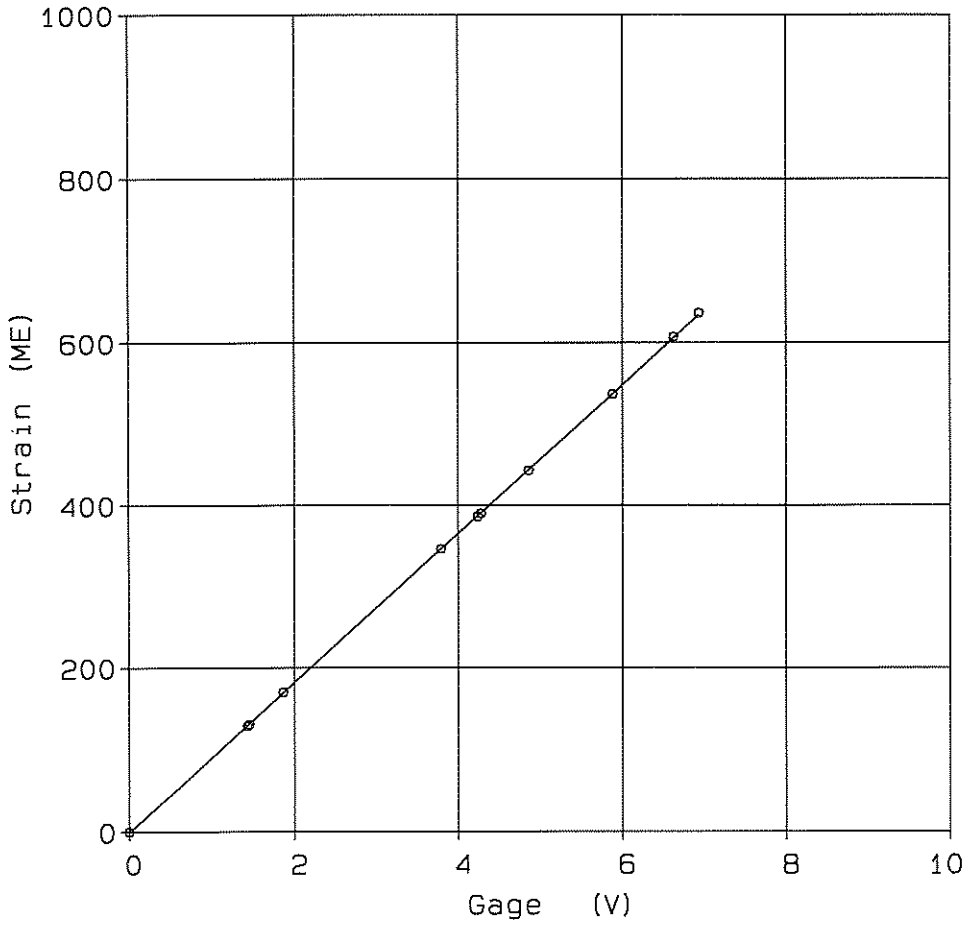

PDA Cal Factor = 91.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 318.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
132	1.46
129	1.44
171	1.87
347	3.79
391	4.28
387	4.25
444	4.87
538	5.88
607	6.64
636	6.94

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 27-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2