Pile Dynamics, Inc.
Transducer 228W

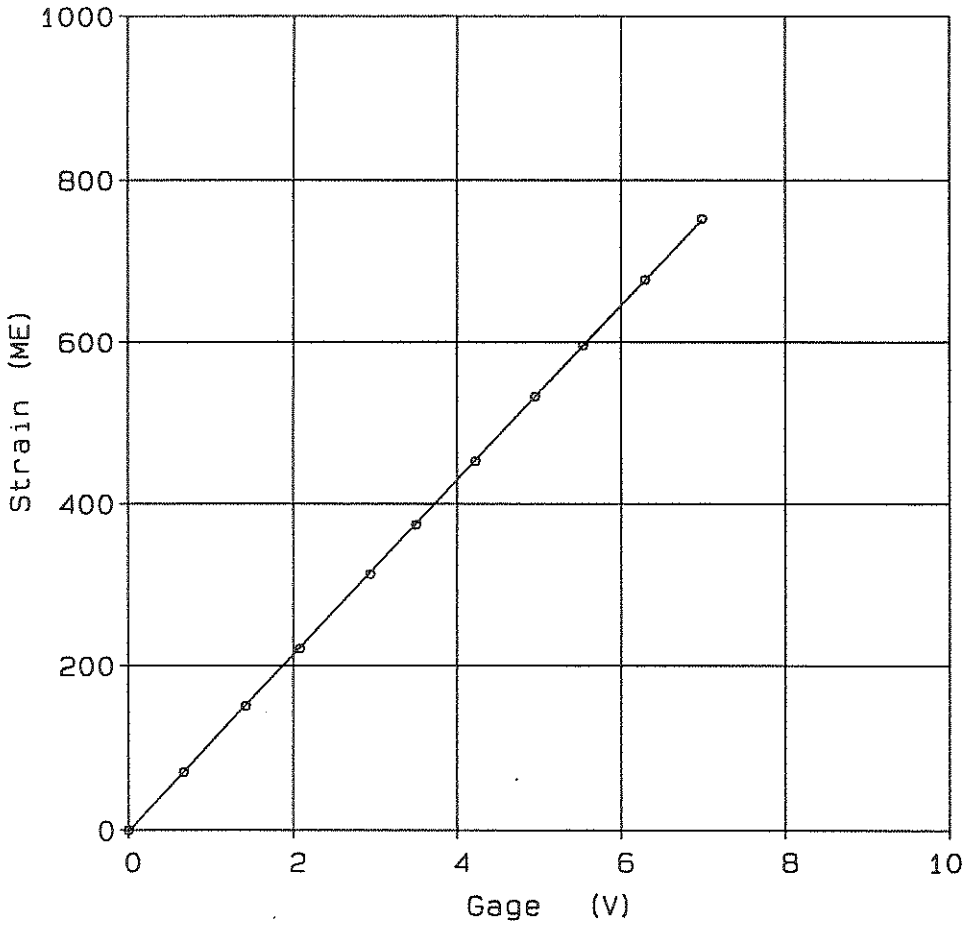

PDA Cal Factor = 107.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.67
151	1.42
221	2.09
314	2.94
374	3.50
452	4.22
532	4.96
597	5.55
678	6.30
753	6.99

Calibrated by: Jim Stabtoff

Calibrated on: 01-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2