Pile Dynamics, Inc.
Transducer 229W

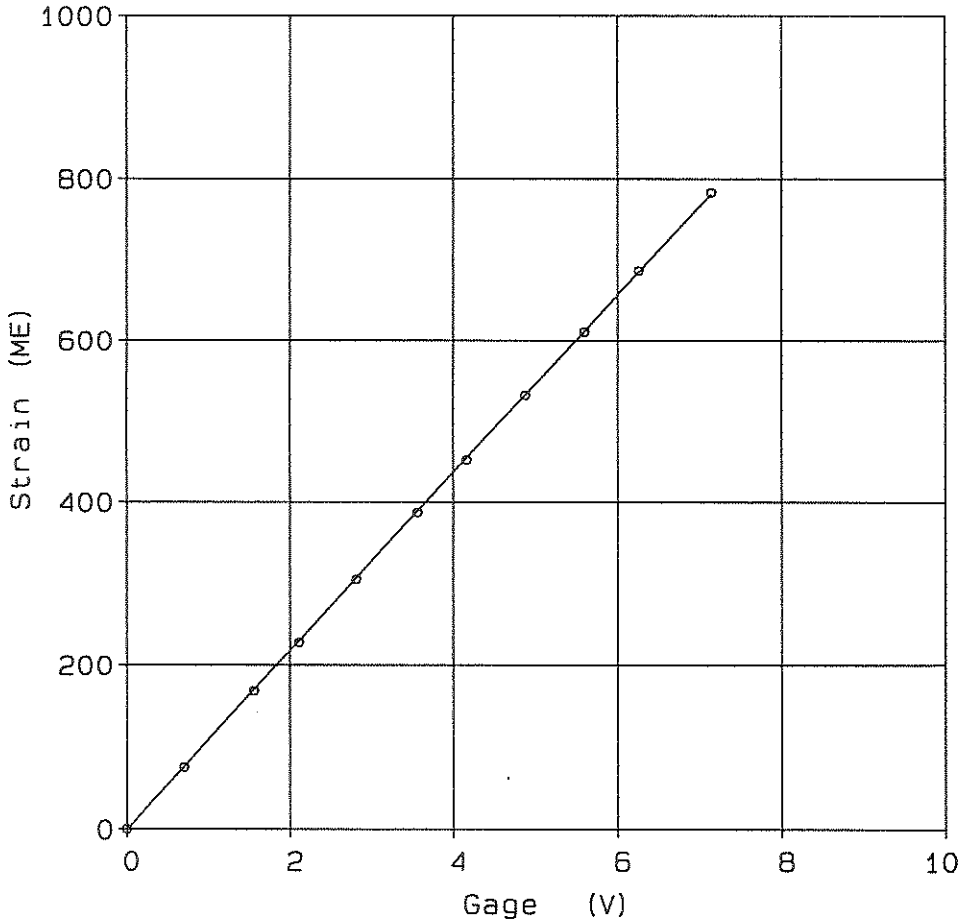

PDA Cal Factor = 109.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 380.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.70
169	1.56
229	2.12
306	2.81
388	3.56
453	4.17
532	4.88
612	5.60
686	6.27
783	7.14

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 02-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2