Pile Dynamics Inc
Transducer 230I

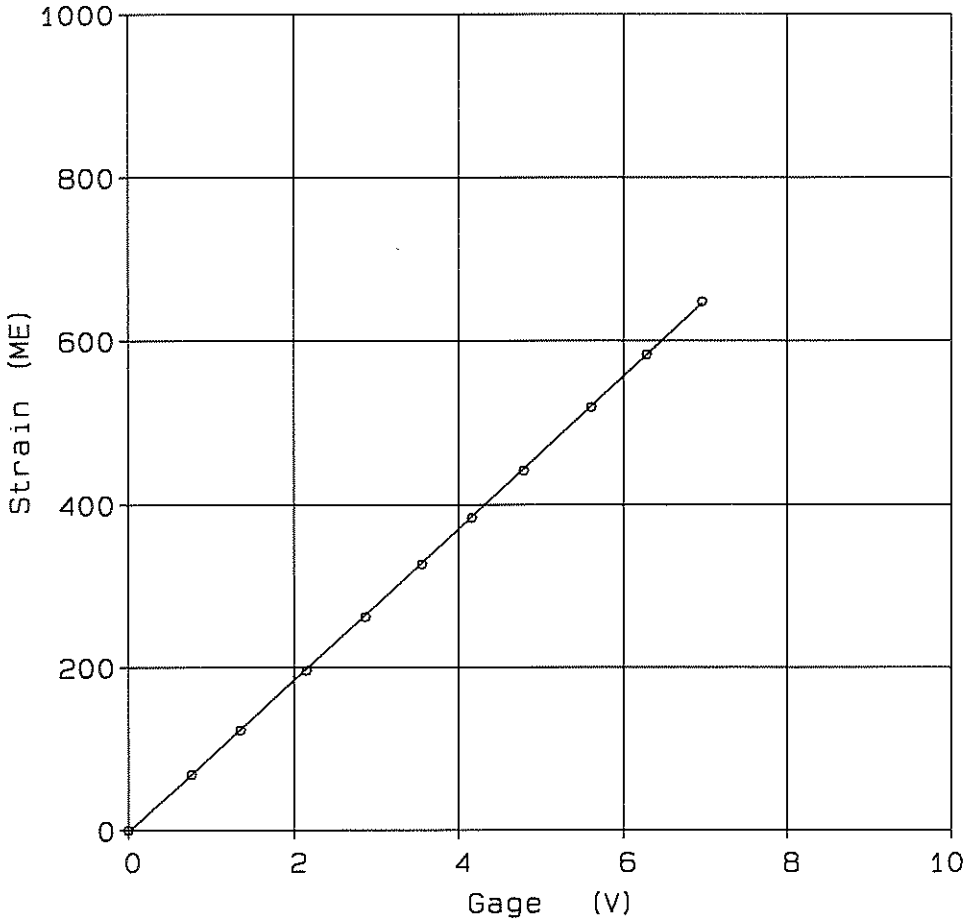

PDA Cal Factor = 93.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 323.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.77
123	1.35
197	2.15
263	2.87
327	3.56
384	4.16
442	4.79
519	5.61
583	6.28
649	6.97

Calibrated by: Jason M Bahr

Calibrated on: 14-May-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2