Pile Dynamics, Inc.
Transducer 230W

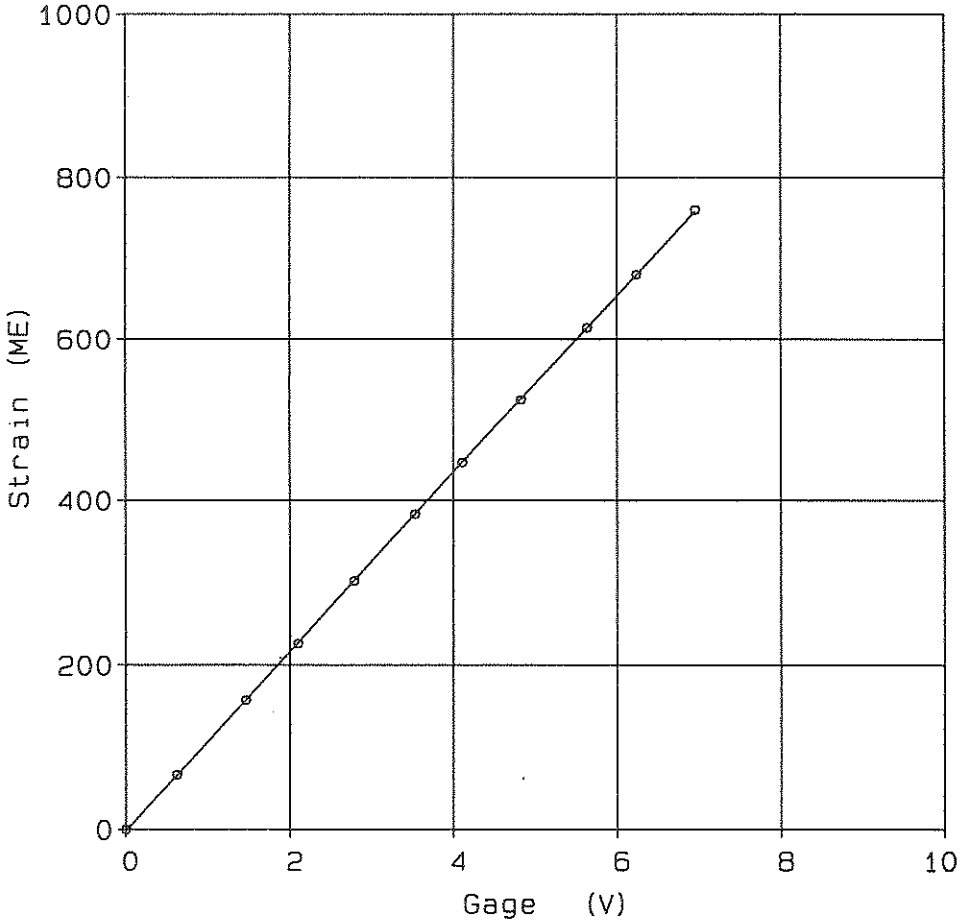

PDA Cal Factor = 109.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 379.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
66	.63
158	1.47
226	2.10
302	2.80
383	3.54
446	4.12
525	4.83
615	5.64
680	6.24
761	6.96

Calibrated by: Jim Deutschmann

Calibrated on: 02-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2