Pile Dynamics, Inc.
Transducer 231W

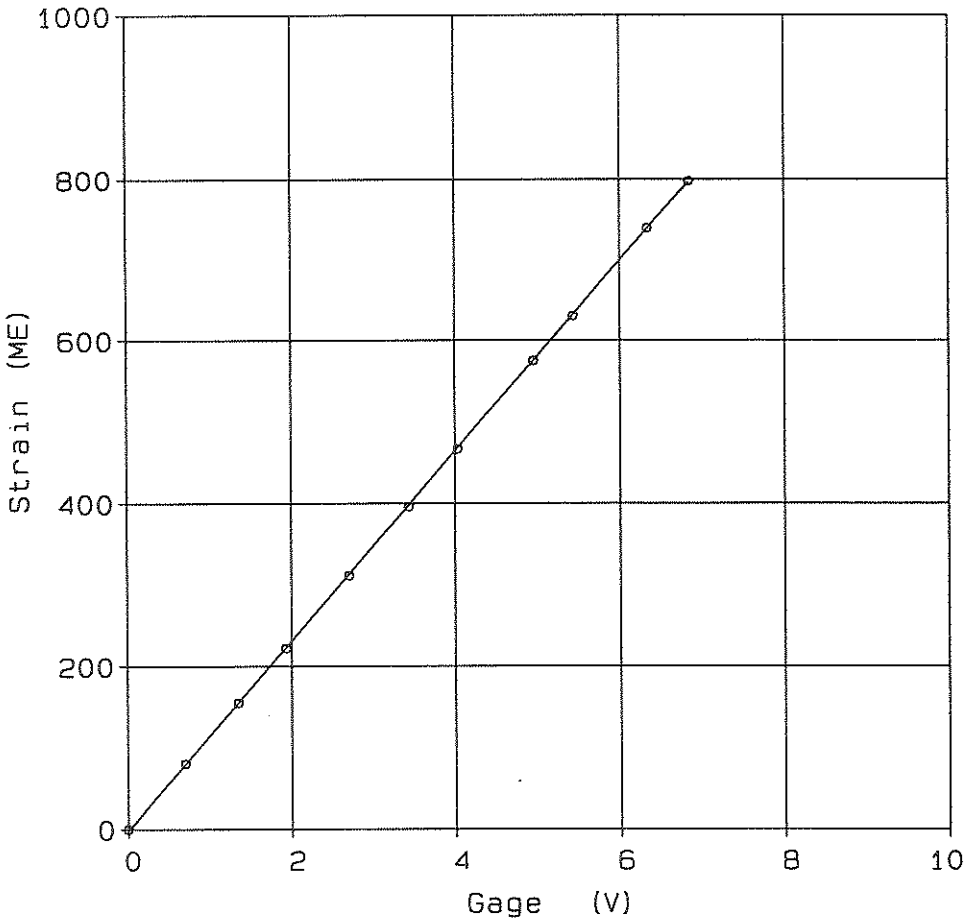

PDA Cal Factor = 116.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 404.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.70
155	1.35
222	1.94
312	2.70
396	3.43
467	4.04
575	4.96
631	5.44
738	6.34
798	6.86

Calibrated by: Jim Stabelfeldt

Calibrated on: 02-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2