Pile Dynamics, Inc.

Transducer 232W

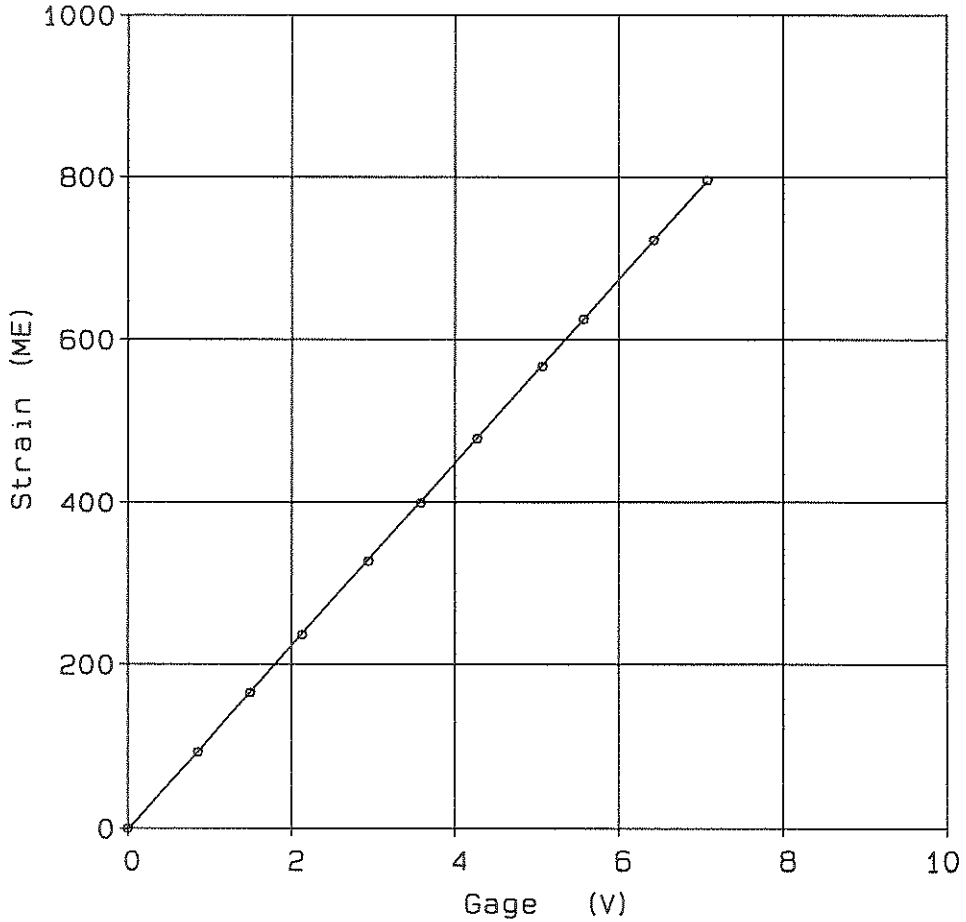

PDA Cal Factor = 112.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 391.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
94	.85
165	1.50
237	2.13
328	2.94
399	3.58
479	4.28
568	5.07
626	5.58
723	6.43
797	7.08

Calibrated by: Jim Stevenson

Calibrated on: 19-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2