Pile Dynamics, Inc.
Transducer 233W

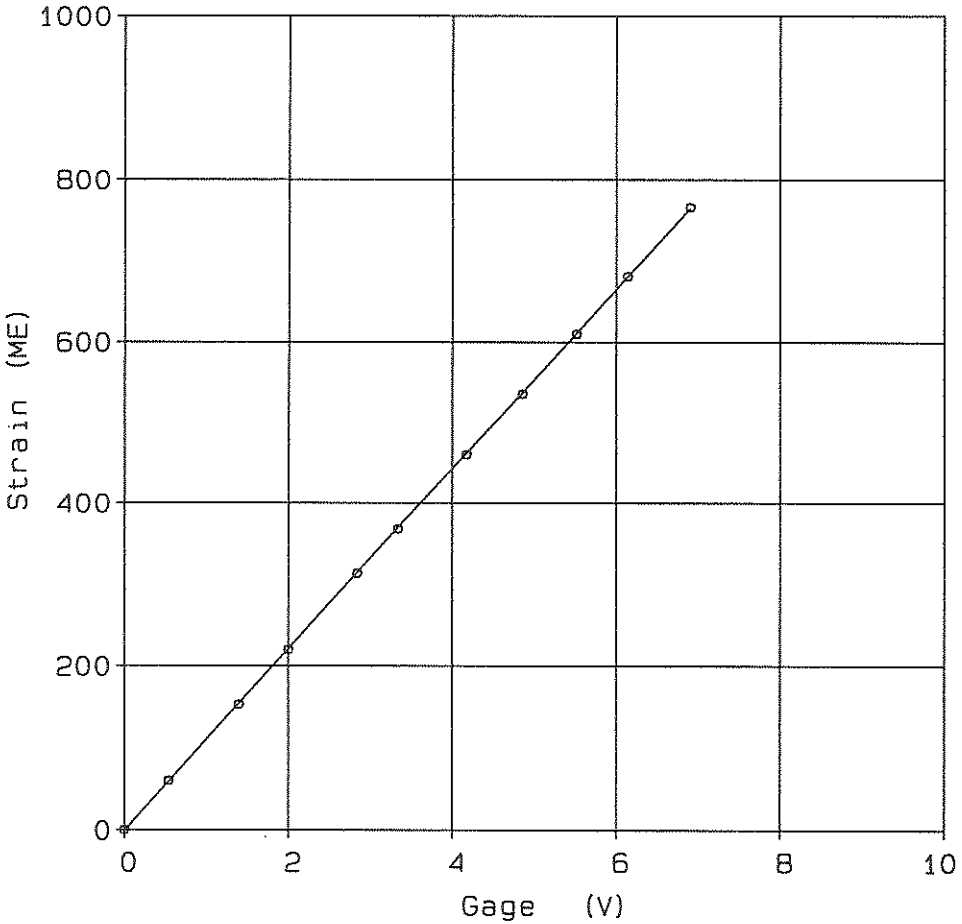

PDA Cal Factor = 111.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 385.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
60	.55
154	1.41
220	2.01
313	2.85
368	3.35
461	4.18
537	4.85
610	5.51
681	6.14
767	6.91

Calibrated by: Jim Stevenson

Calibrated on: 19-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2