Pile Dynamics Inc
Transducer 234I

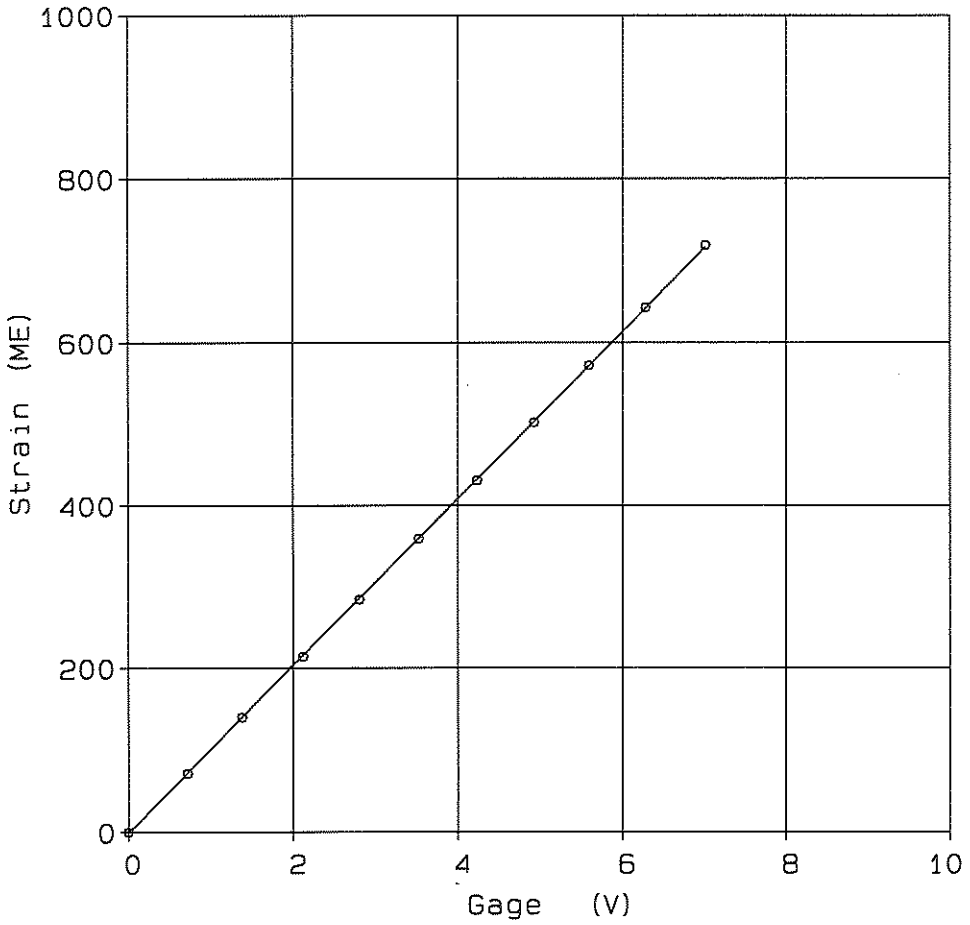

PDA Cal Factor = 102.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 356.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
73	.72
140	1.38
215	2.12
284	2.80
359	3.53
432	4.24
503	4.93
573	5.60
643	6.28
720	7.01

Calibrated by: _____

Calibrated on: 14-May-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2