Pile Dynamics, Inc.
Transducer 234W

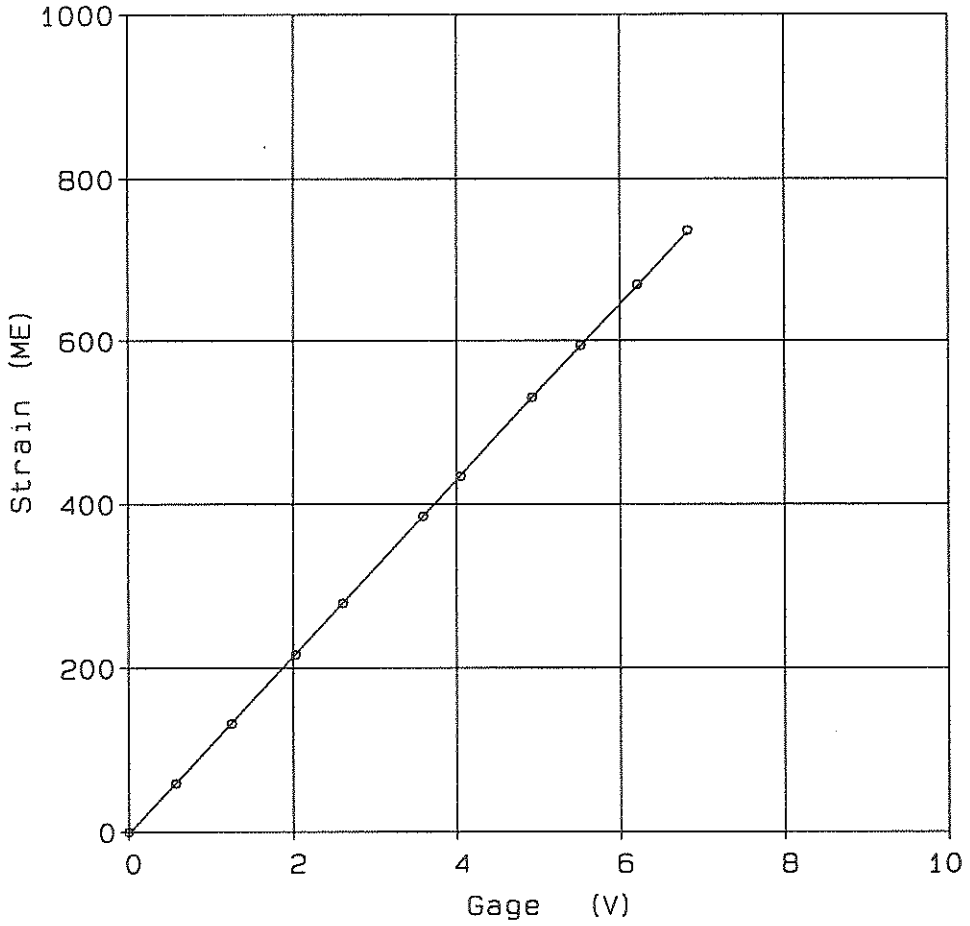

PDA Cal Factor = 108.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 375.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
60	.58
133	1.25
216	2.03
279	2.61
385	3.60
435	4.06
530	4.93
594	5.52
671	6.22
737	6.83

Calibrated by: Jim Dunlap

Calibrated on: 19-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2