Pile Dynamics, Inc.
Transducer 235W

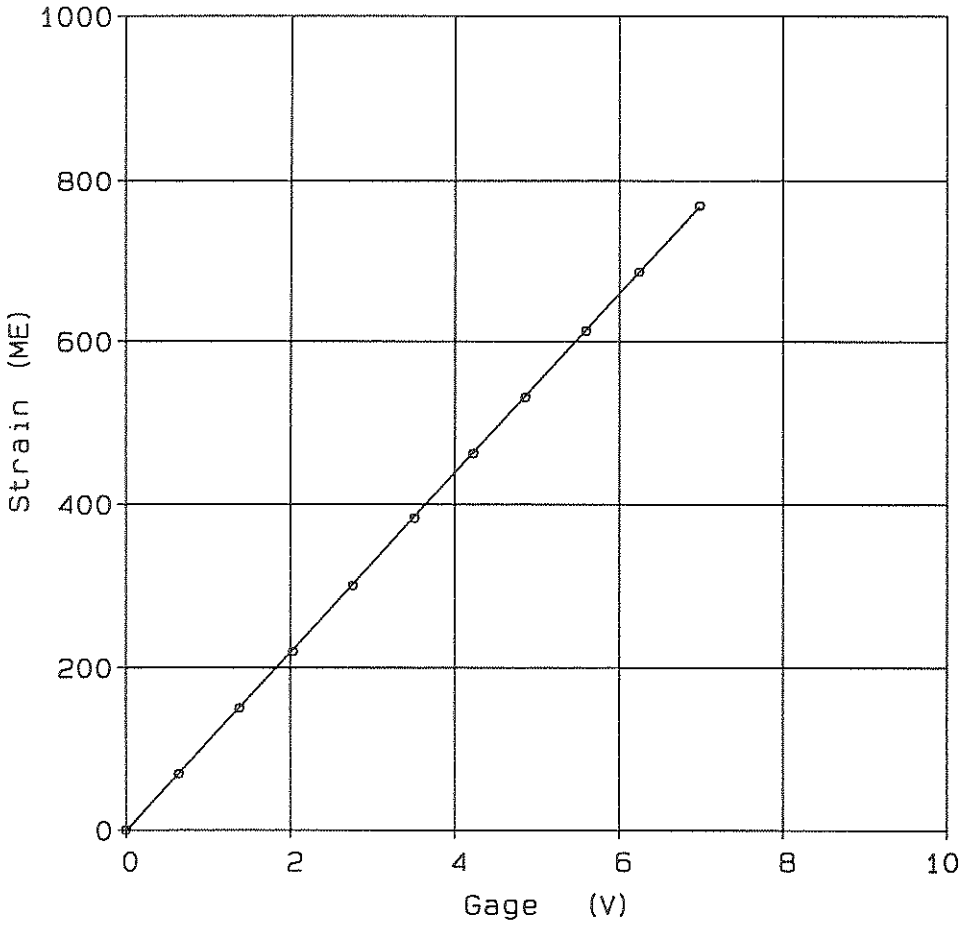

PDA Cal Factor = 110.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 382.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.65
150	1.39
221	2.03
301	2.76
384	3.52
462	4.22
531	4.85
614	5.59
686	6.25
769	6.99

Calibrated by: Jim Gentilcore

Calibrated on: 19-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2