Pile Dynamics, Inc.
Transducer 236W

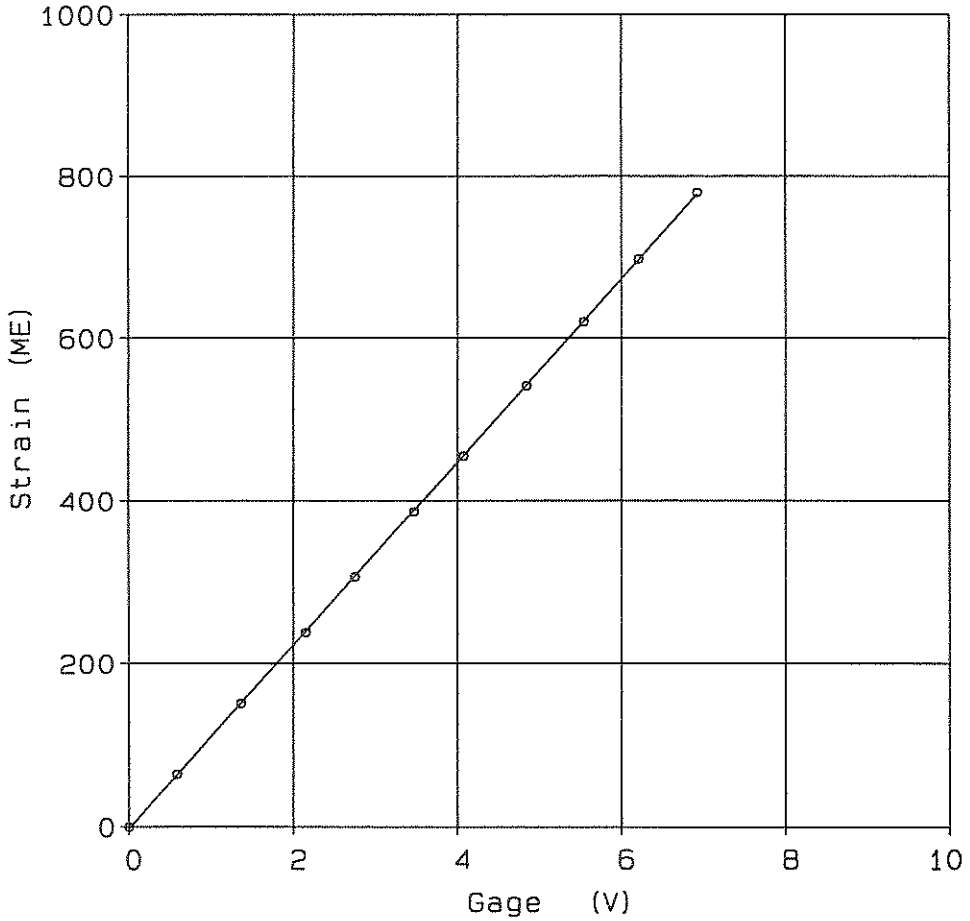

PDA Cal Factor = 112.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 390.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
65	.59
150	1.36
239	2.15
306	2.76
387	3.47
455	4.08
541	4.84
621	5.54
698	6.22
780	6.94

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 19-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2