
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 237W

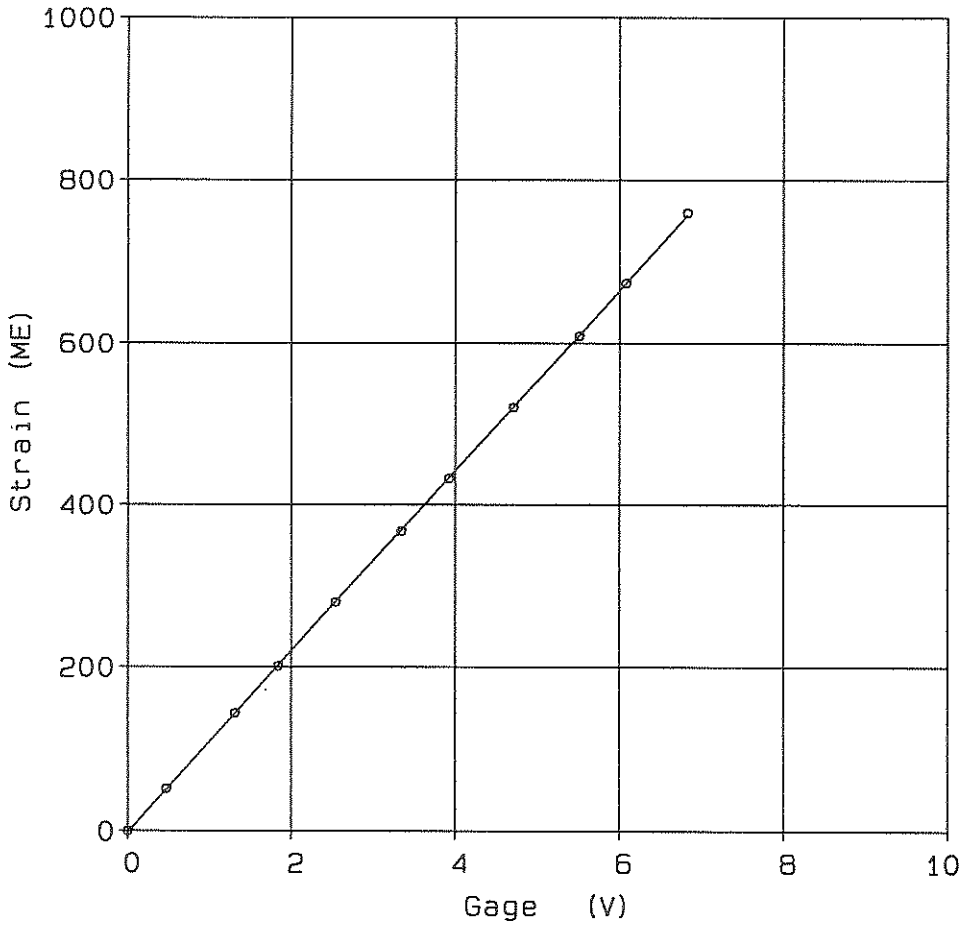

PDA Cal Factor = 111.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 385.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
51	.48
144	1.32
201	1.85
279	2.55
367	3.35
432	3.93
520	4.72
610	5.51
673	6.08
760	6.84

Calibrated by: Jim Sentelhoff

Calibrated on: 20-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2