
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 238W

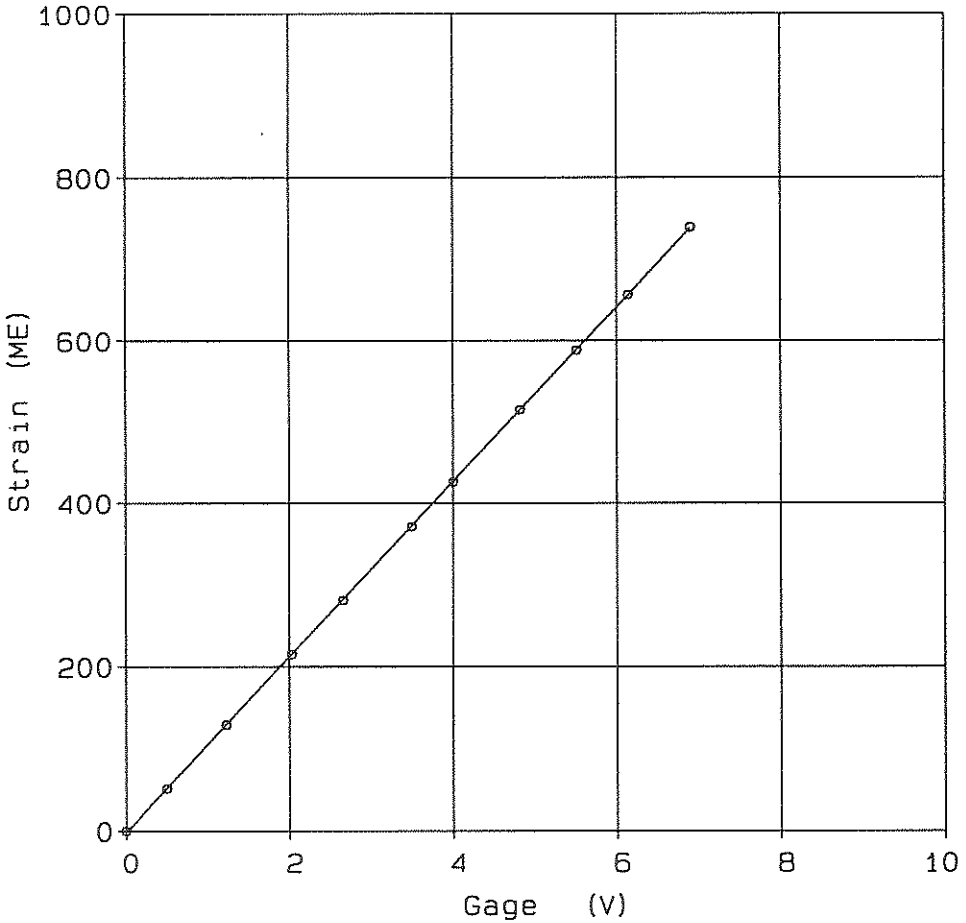

PDA Cal Factor = 107.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 372.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
52	.51
130	1.23
215	2.04
281	2.65
371	3.49
426	4.00
515	4.83
588	5.51
657	6.14
740	6.91

Calibrated by: Jim S. Rutledge

Calibrated on: 20-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2