
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 240W

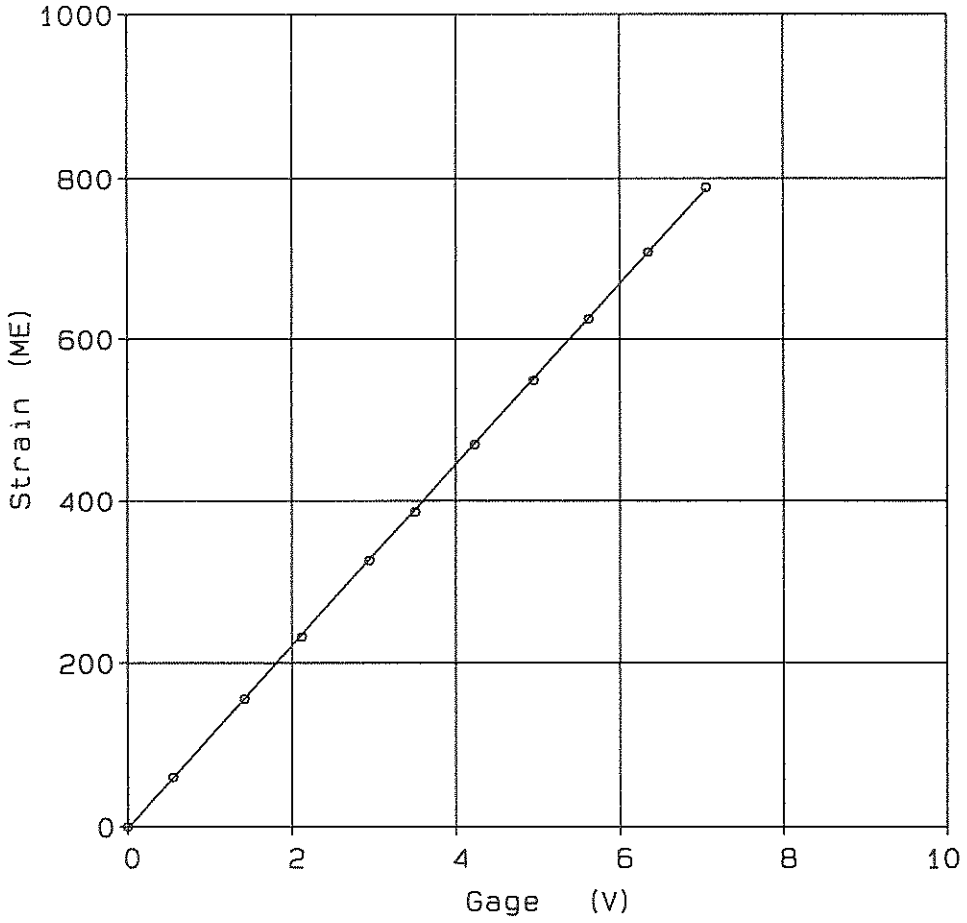

PDA Cal Factor = 111.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 387.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
60	.55
156	1.42
233	2.12
326	2.95
387	3.50
470	4.23
550	4.95
626	5.62
708	6.36
789	7.07

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 21-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2