
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 241W

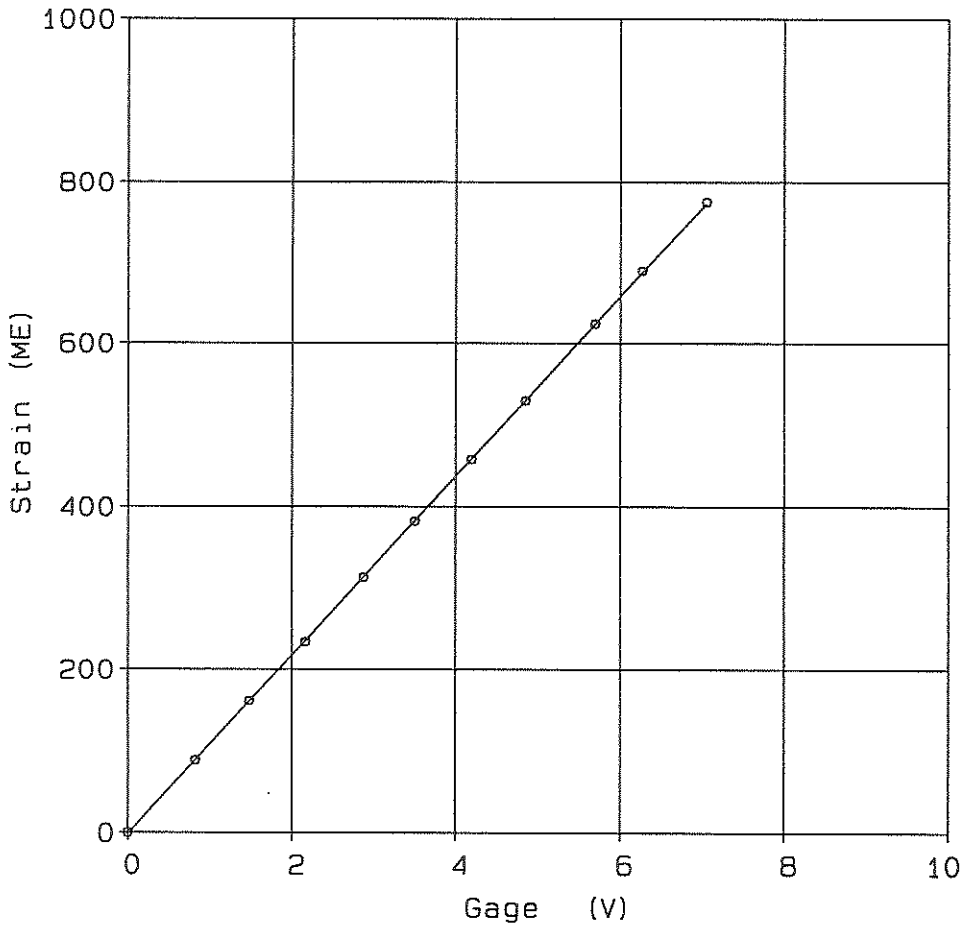

PDA Cal Factor = 110.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 382.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.82
161	1.49
234	2.16
313	2.88
383	3.51
459	4.20
530	4.84
625	5.70
689	6.28
775	7.05

Calibrated by: Jim Stabelduff

Calibrated on: 19-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2