
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 242W

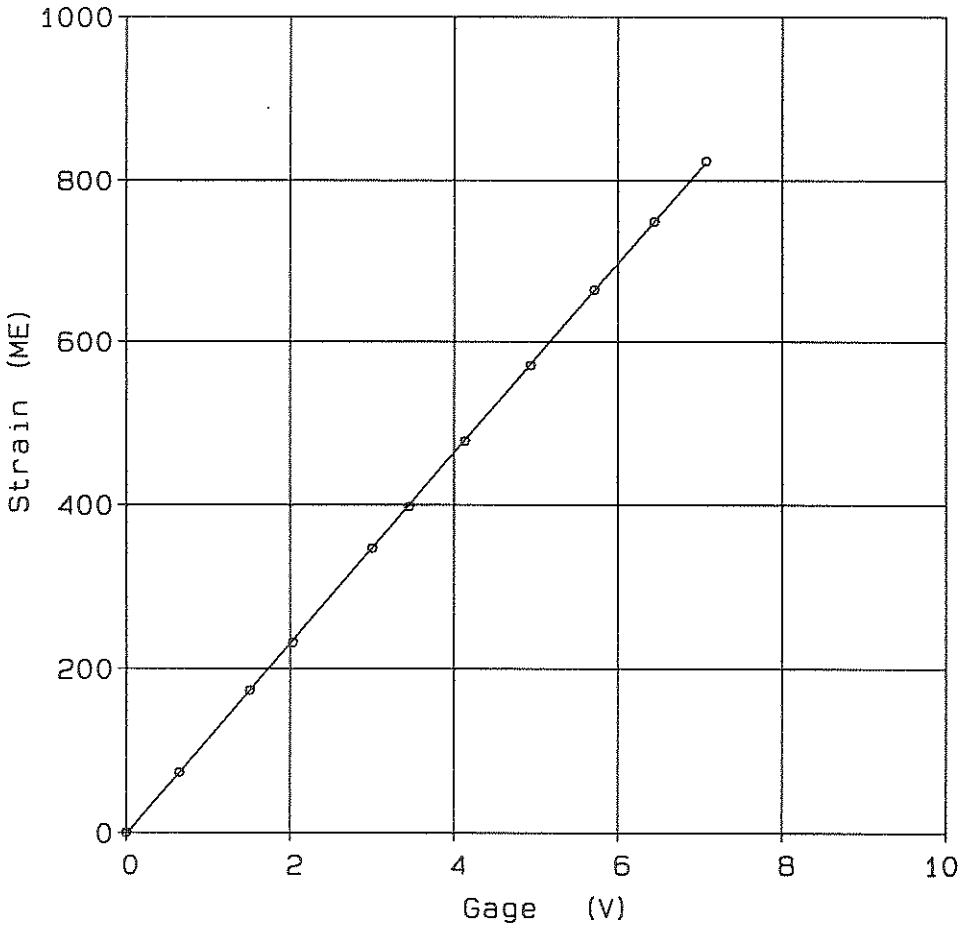

PDA Cal Factor = 116.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 405.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.66
174	1.52
233	2.03
348	3.01
399	3.46
478	4.13
572	4.94
665	5.71
750	6.44
825	7.07

Calibrated by: Jim Dunlap

Calibrated on: 20-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2