
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 243W

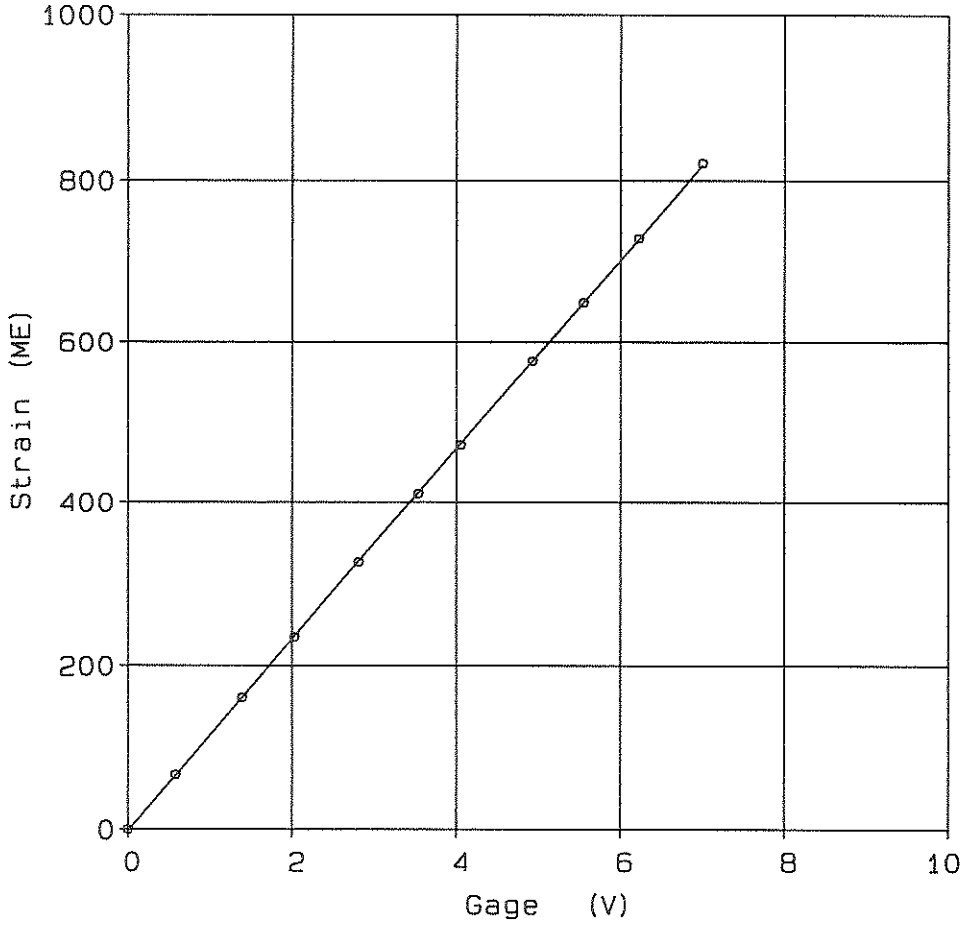

PDA Cal Factor	=	117.5 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	407.8 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.59
161	1.40
236	2.04
326	2.81
411	3.53
472	4.05
576	4.93
650	5.56
729	6.23
822	7.00

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 20-Dec-94