Pile Dynamics, Inc.
Transducer 245W

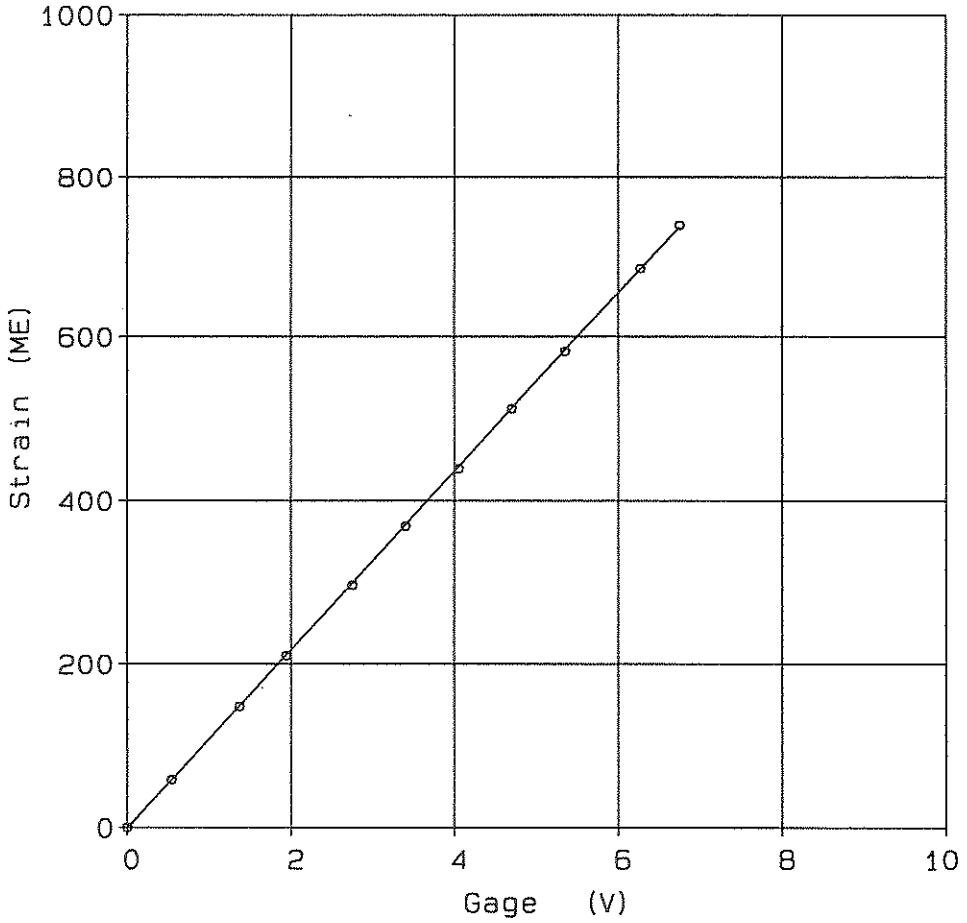

PDA Cal Factor = 109.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 379.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
59	.54
148	1.37
211	1.95
298	2.75
370	3.41
440	4.06
513	4.71
583	5.36
685	6.28
739	6.76

Calibrated by: Jim Stentzwolff

Calibrated on: 21-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2