
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 246W

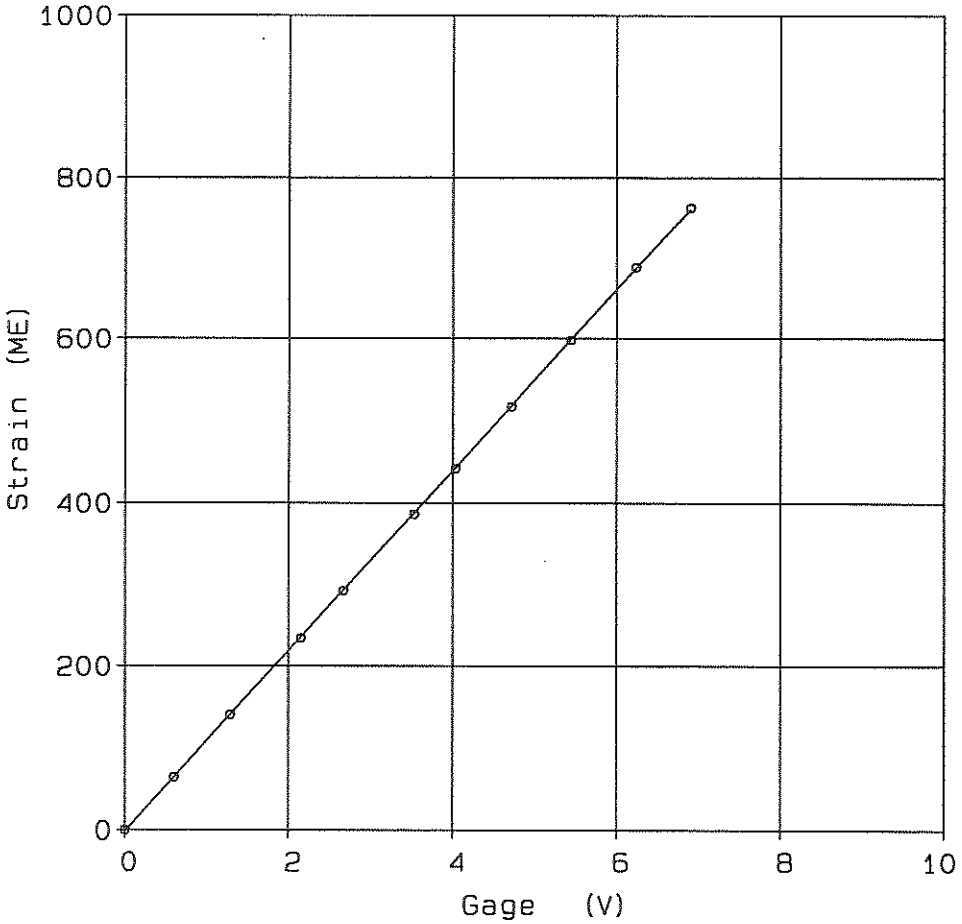

PDA Cal Factor = 110.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 383.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.60
140	1.29
235	2.16
292	2.68
386	3.53
443	4.03
517	4.71
598	5.44
688	6.24
763	6.91

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 21-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2