Pile Dynamics Inc
Transducer 247I

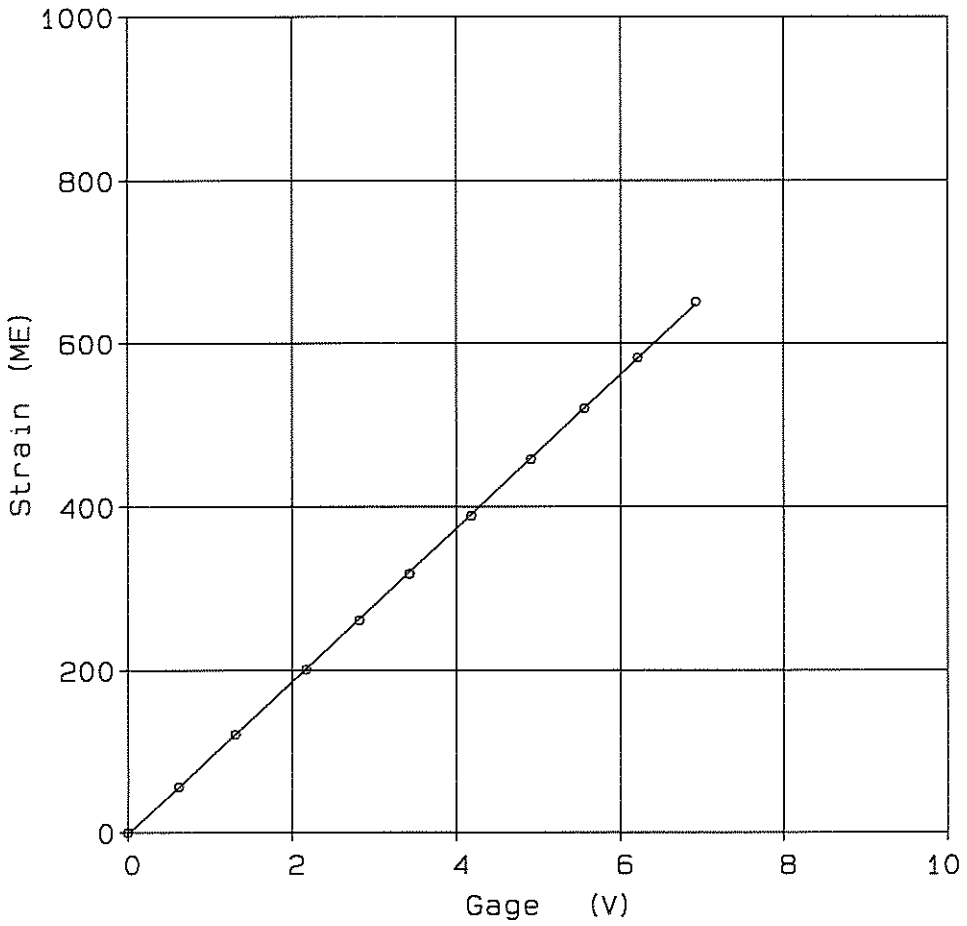

PDA Cal Factor = 94.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 326.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
57	.63
121	1.32
201	2.18
262	2.82
319	3.43
390	4.18
458	4.91
520	5.57
582	6.21
652	6.93

Calibrated by: _____

Calibrated on: 14-May-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2