
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 247W

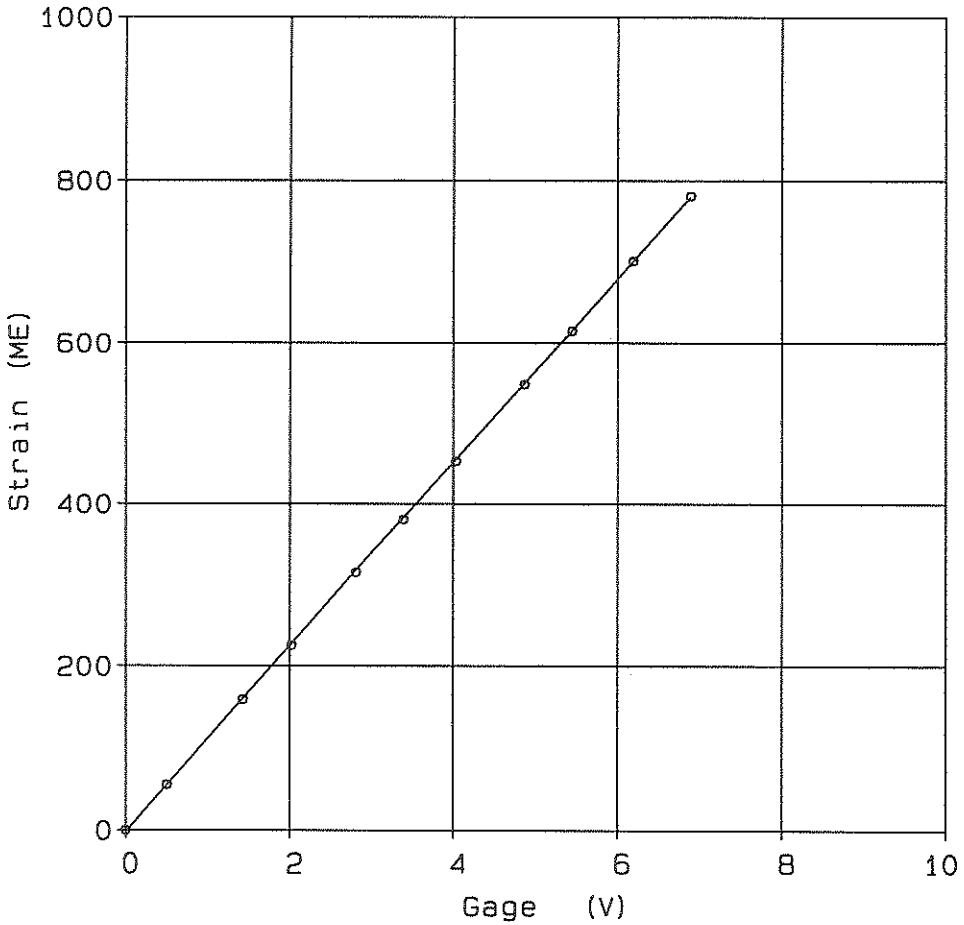

PDA Cal Factor = 113.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 394.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
56	.51
160	1.43
225	2.03
315	2.81
381	3.40
454	4.03
549	4.86
616	5.45
702	6.20
782	6.90

Calibrated by: Jim Stabelfeldt

Calibrated on: 21-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2