Pile Dynamics Inc
Transducer 248I

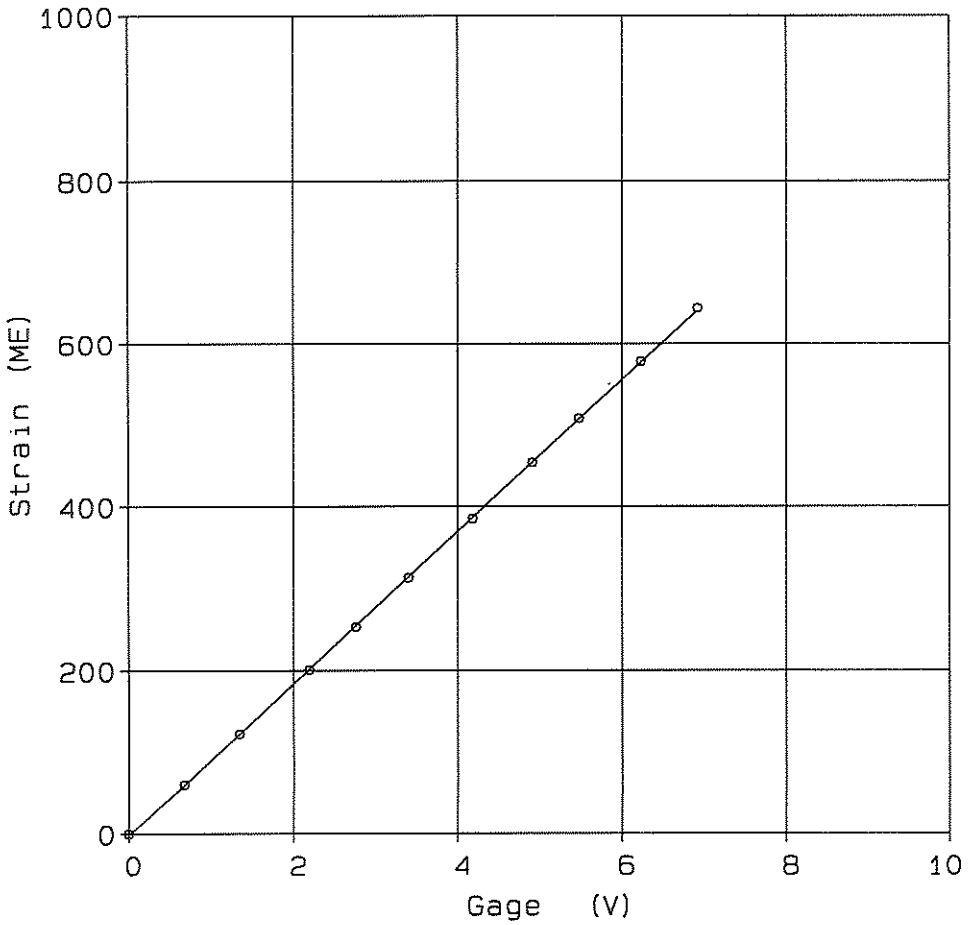

PDA Cal Factor = 93.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 323.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
62	.68
124	1.35
201	2.20
254	2.76
313	3.41
385	4.18
454	4.92
508	5.48
579	6.24
644	6.92

Calibrated by: _____

Calibrated on: 14-May-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2