
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 248W

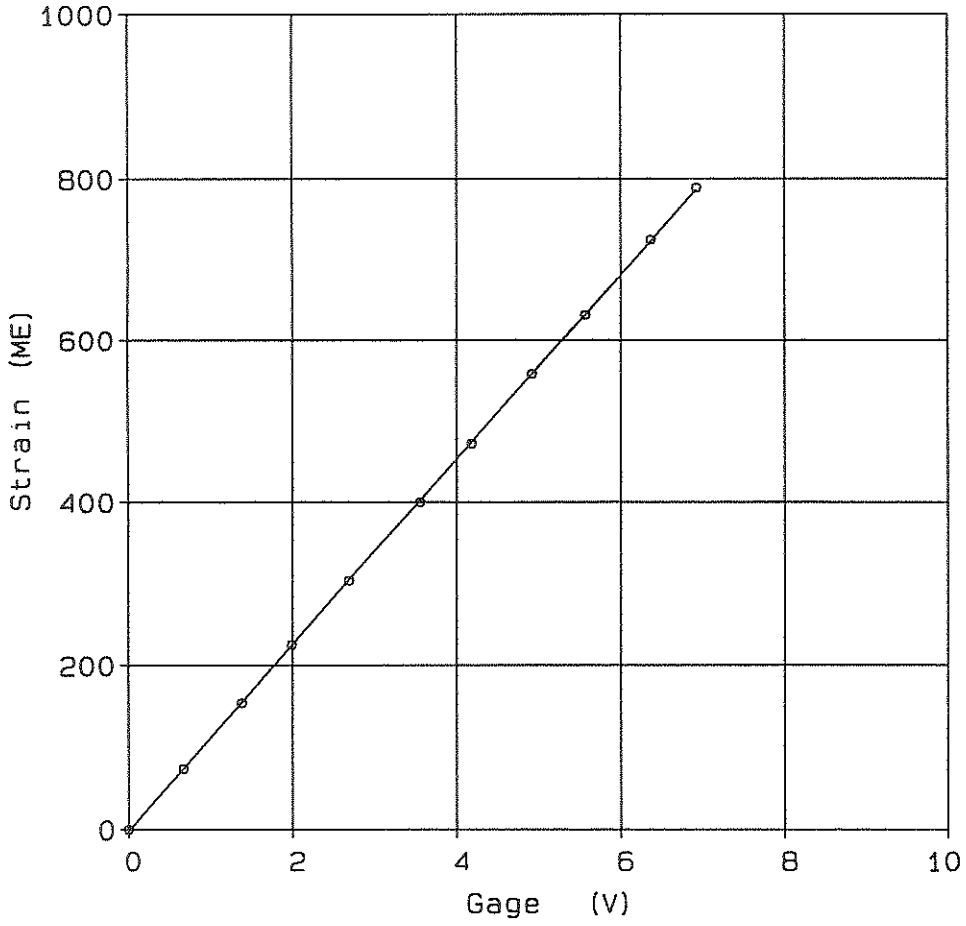

PDA Cal Factor = 113.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 395.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.67
155	1.38
225	2.00
303	2.70
401	3.55
473	4.18
558	4.93
633	5.58
725	6.38
789	6.94

Calibrated by: Jim Sentelhoff

Calibrated on: 21-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2