Pile Dynamics Inc
Transducer 249I

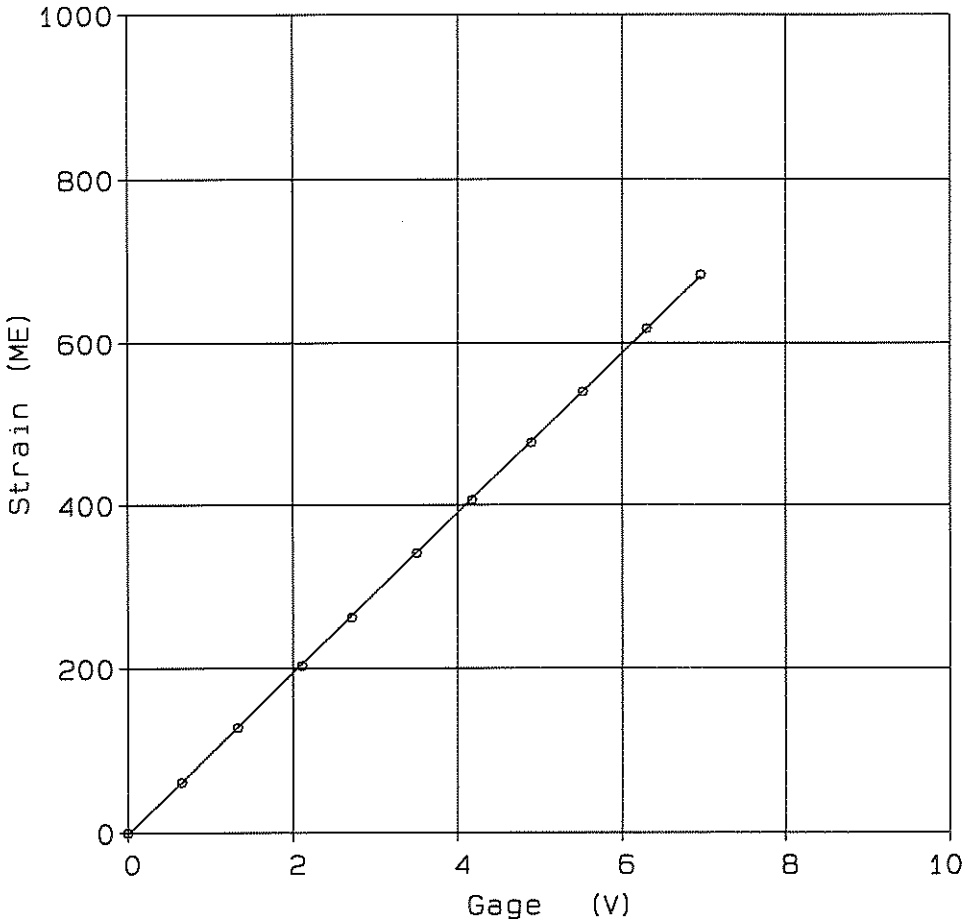

PDA Cal Factor = 98.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 341.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
63	.65
129	1.33
204	2.11
263	2.72
341	3.51
407	4.18
478	4.89
540	5.52
618	6.30
685	6.97

Calibrated by: _____

Calibrated on: 14-May-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2