
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 249W

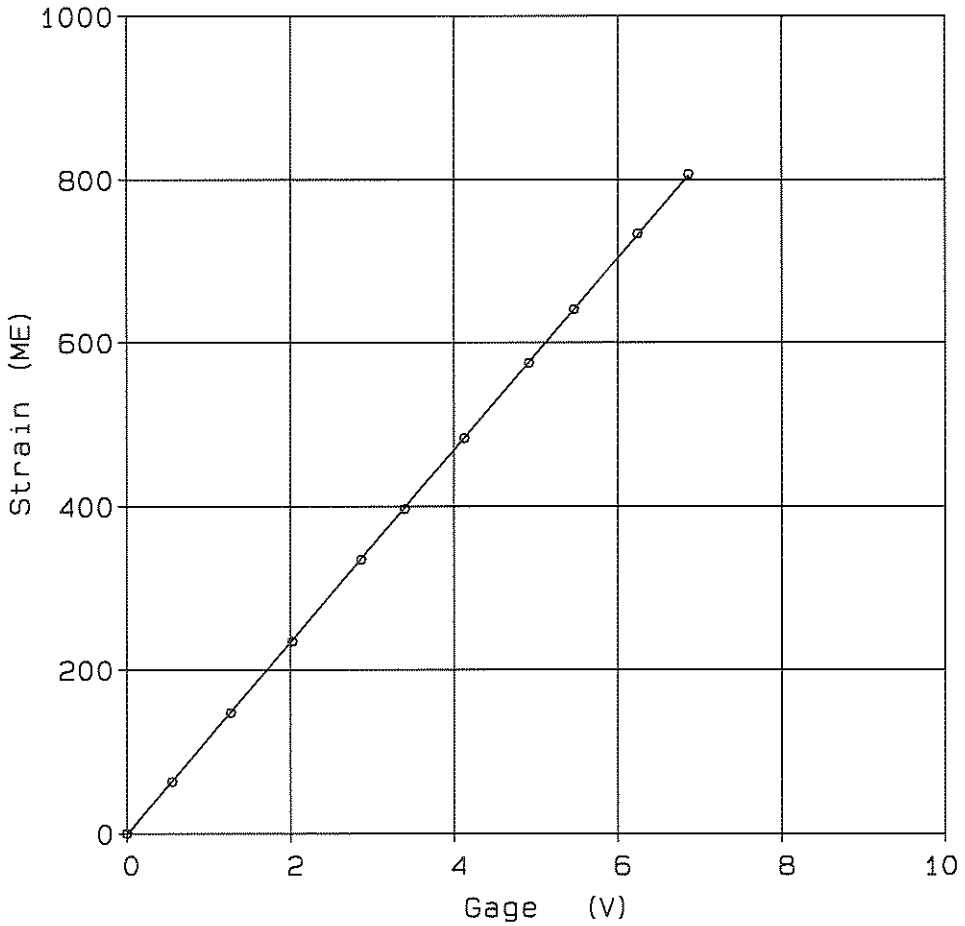

PDA Cal Factor = 117.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 408.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.55
148	1.27
235	2.03
336	2.88
397	3.41
483	4.13
575	4.91
642	5.47
734	6.25
807	6.86

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2