Pile Dynamics Inc
Transducer 250I

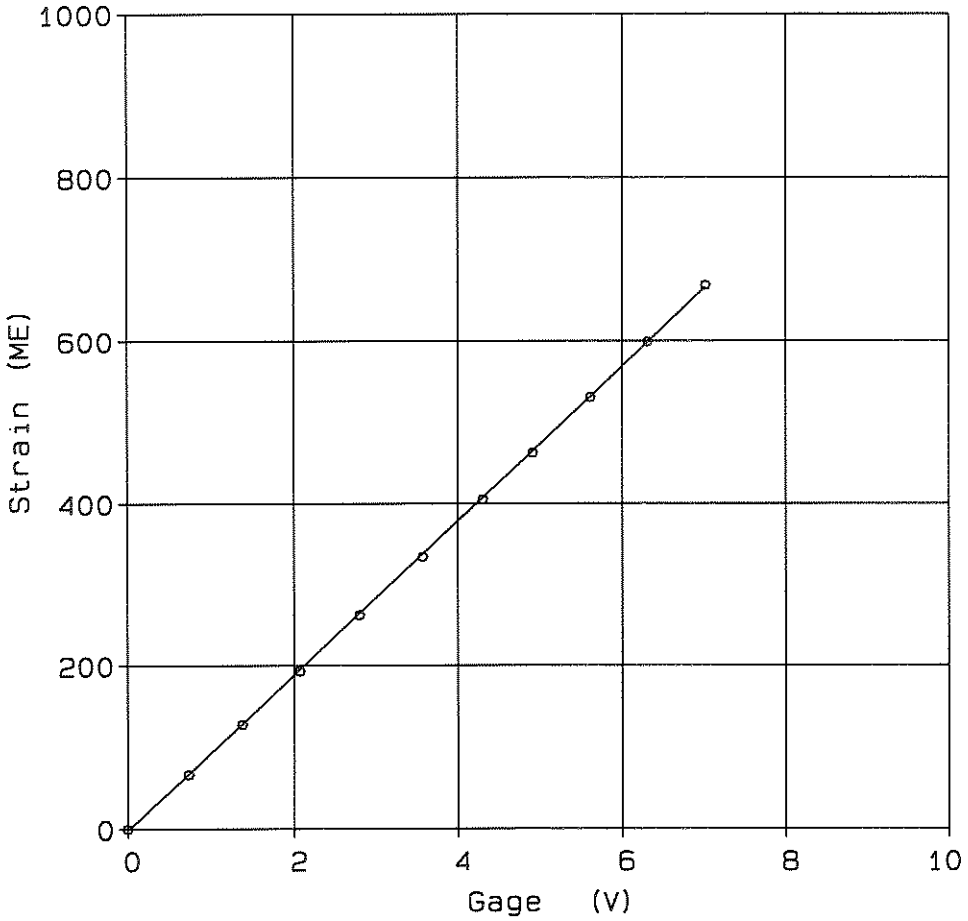

PDA Cal Factor	=	95.1 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	330.4 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.73
129	1.38
194	2.07
262	2.81
335	3.57
406	4.30
464	4.91
531	5.62
600	6.31
668	7.03

Calibrated by: Jason M Gook

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2