
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 250W

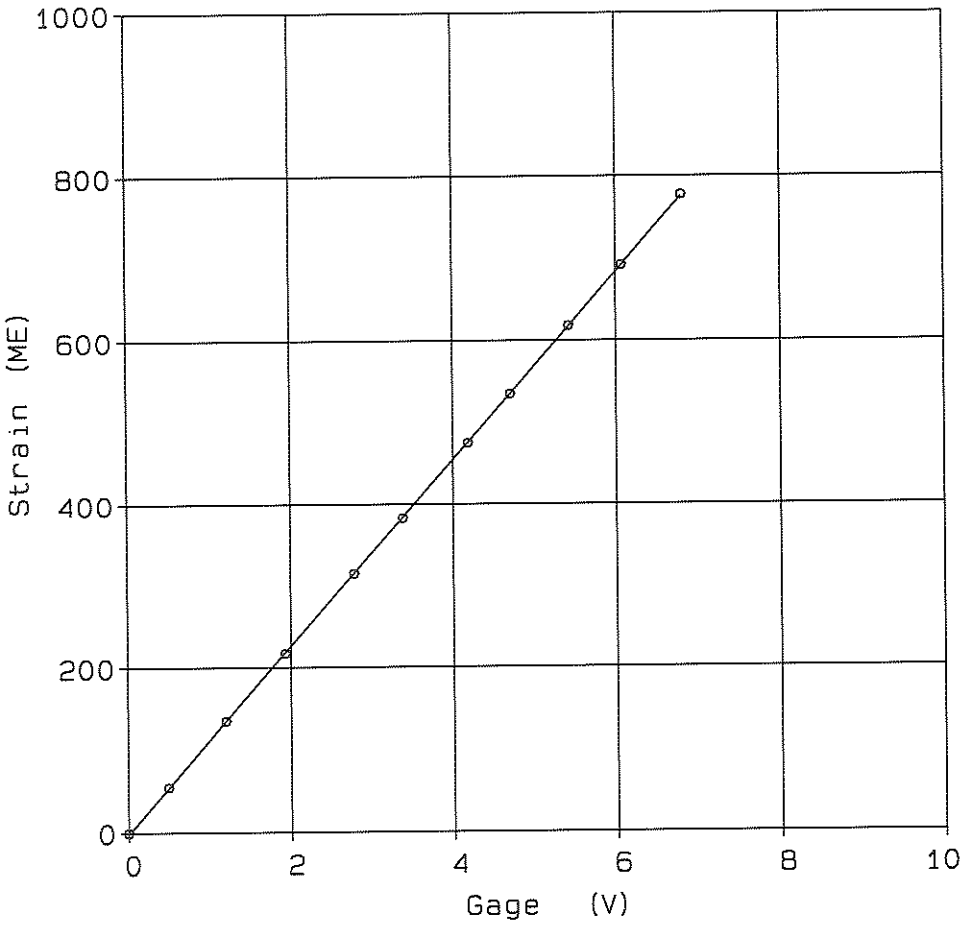

PDA Cal Factor	=	114.4 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	397.1 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
55	.50
135	1.20
218	1.94
315	2.79
383	3.39
475	4.18
535	4.71
619	5.43
693	6.07
777	6.80

Calibrated by: Jim Deutsch

Calibrated on: 29-Dec-94