Pile Dynamics Inc
Transducer 251I

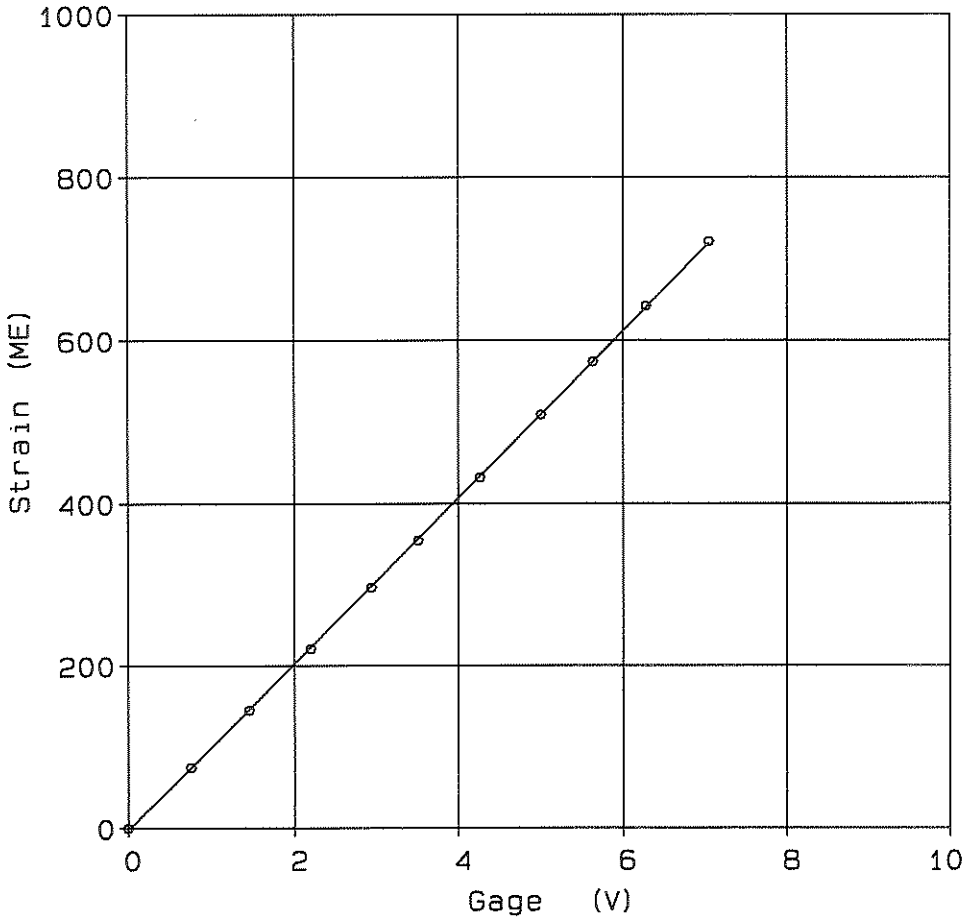

PDA Cal Factor = 102.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 355.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.76
146	1.45
222	2.21
298	2.95
356	3.52
433	4.26
510	5.01
574	5.63
642	6.29
721	7.06

Calibrated by: Jason M Gish

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2