
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 251W

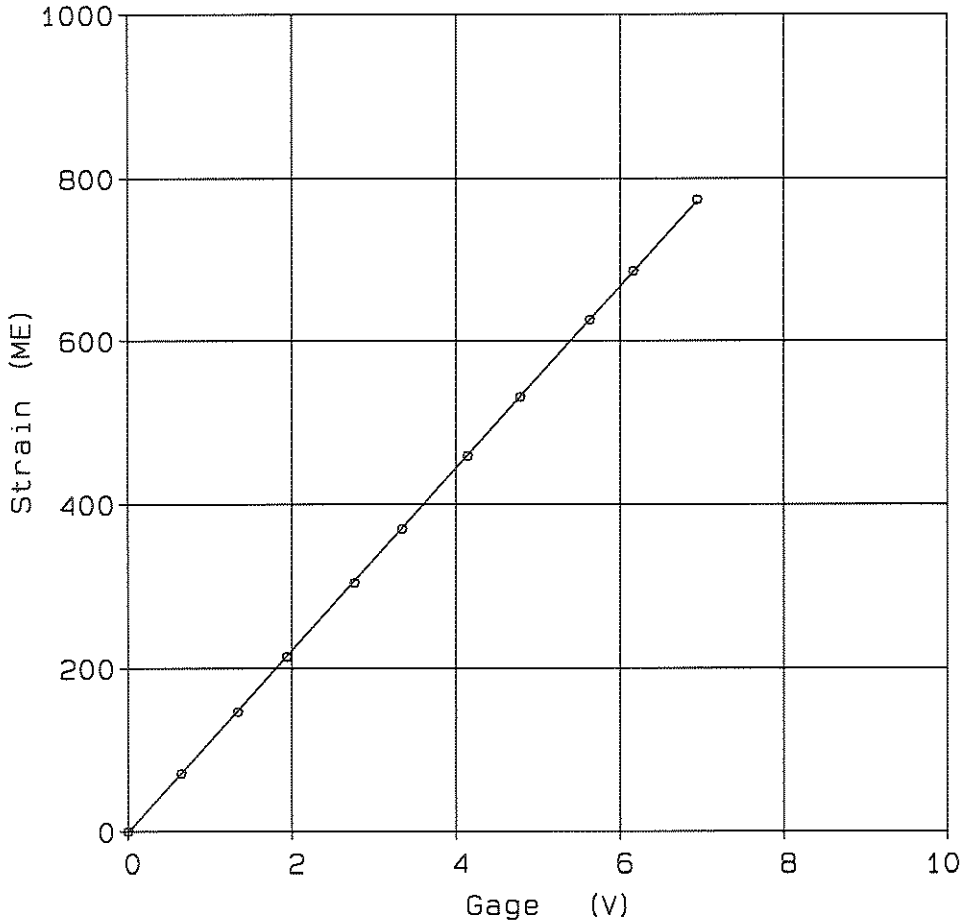

PDA Cal Factor = 111.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 387.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.65
148	1.34
215	1.94
305	2.76
370	3.34
460	4.15
532	4.78
627	5.63
687	6.17
775	6.94

Calibrated by: Jim Deutschelff

Calibrated on: 29-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2