Pile Dynamics Inc
Transducer 252I

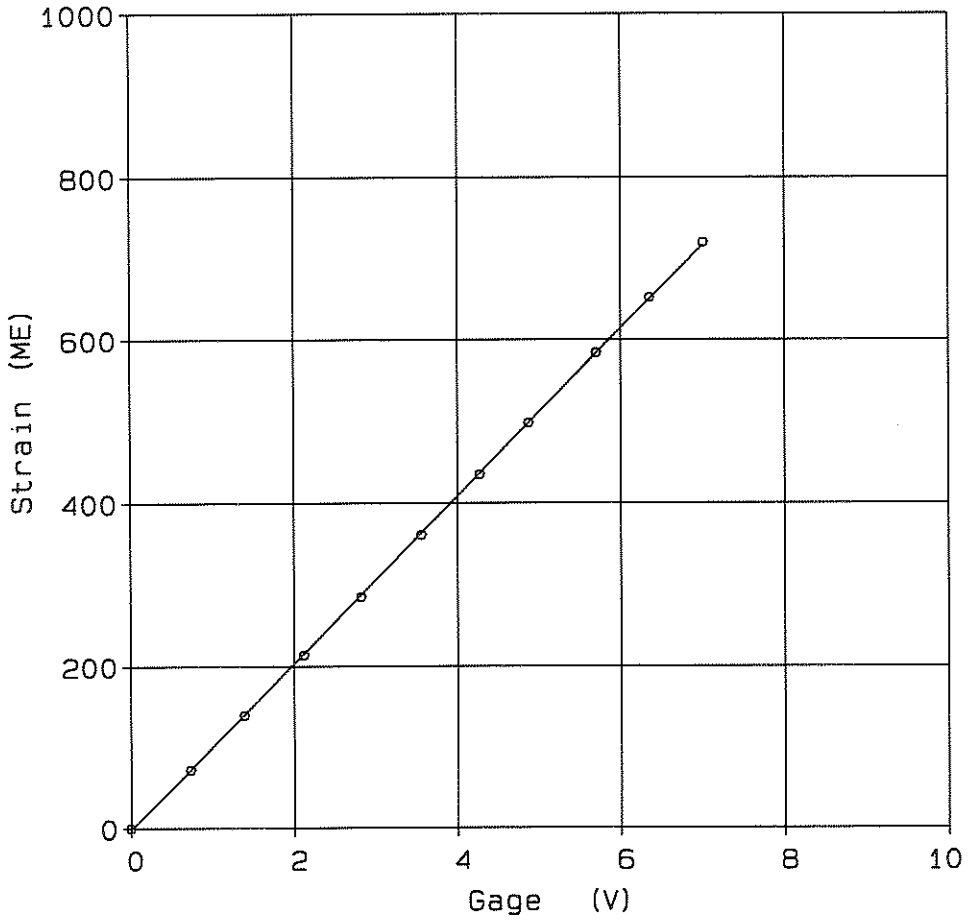

PDA Cal Factor = 102.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 357.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
74	.73
141	1.40
215	2.13
286	2.82
362	3.56
435	4.27
498	4.87
584	5.70
652	6.35
720	7.00

Calibrated by: Jason M Bahr

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2