
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 252W

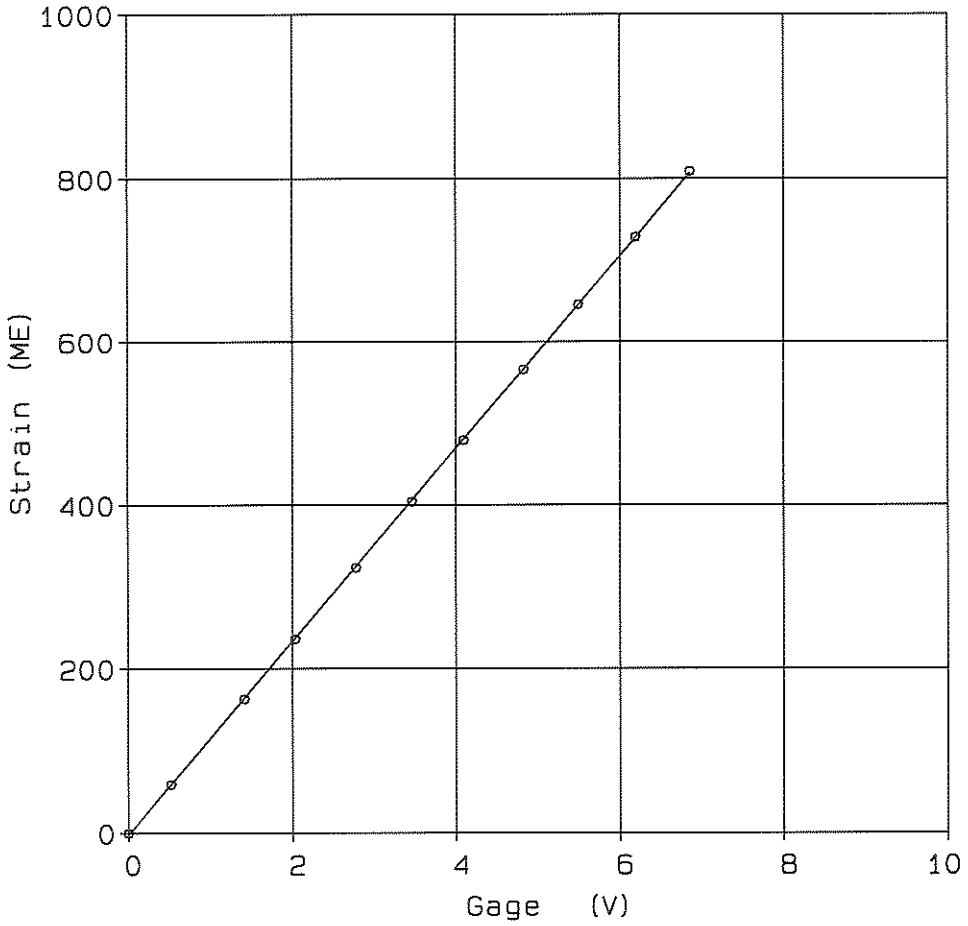

PDA Cal Factor = 118.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 409.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
60	.52
164	1.41
237	2.04
323	2.78
404	3.46
479	4.09
567	4.83
646	5.50
729	6.20
810	6.87

Calibrated by: Jim Stuteville

Calibrated on: 29-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2