
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 253W

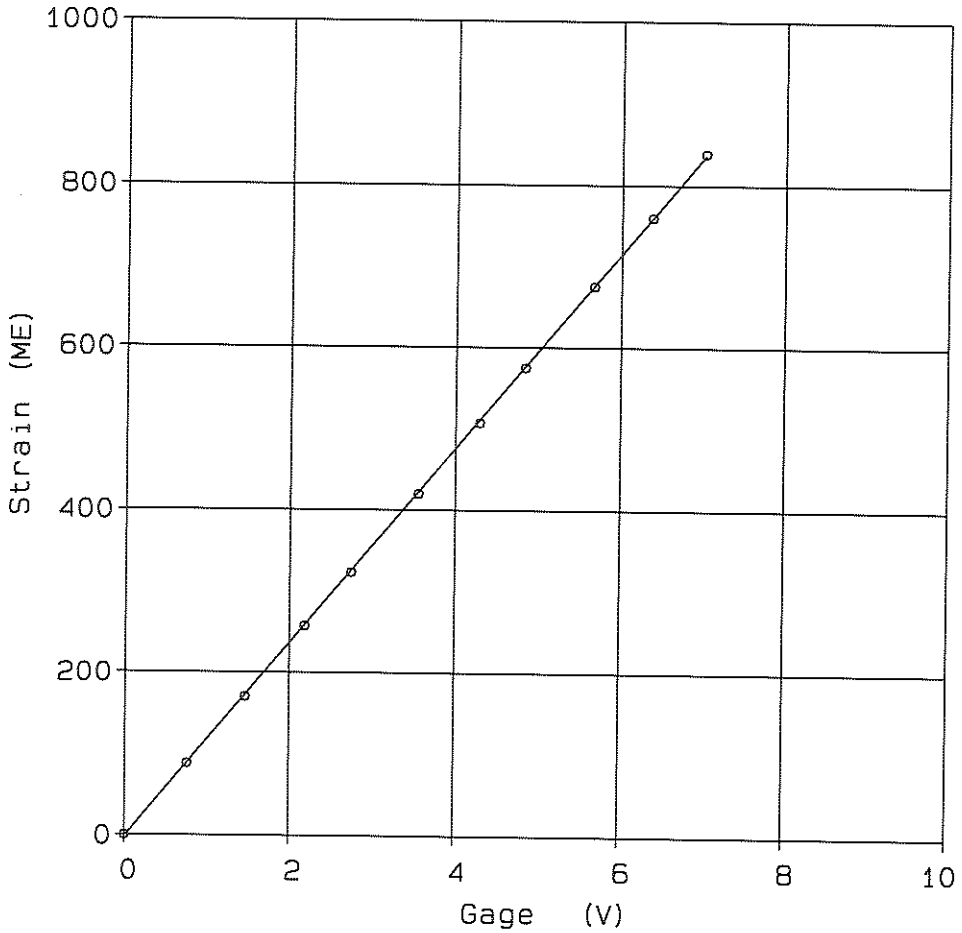

PDA Cal Factor = 119.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 415.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.76
171	1.46
257	2.19
323	2.75
420	3.55
508	4.29
576	4.85
675	5.68
760	6.38
839	7.03

Calibrated by: Jim Stentoff

Calibrated on: 29-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2