
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 254W

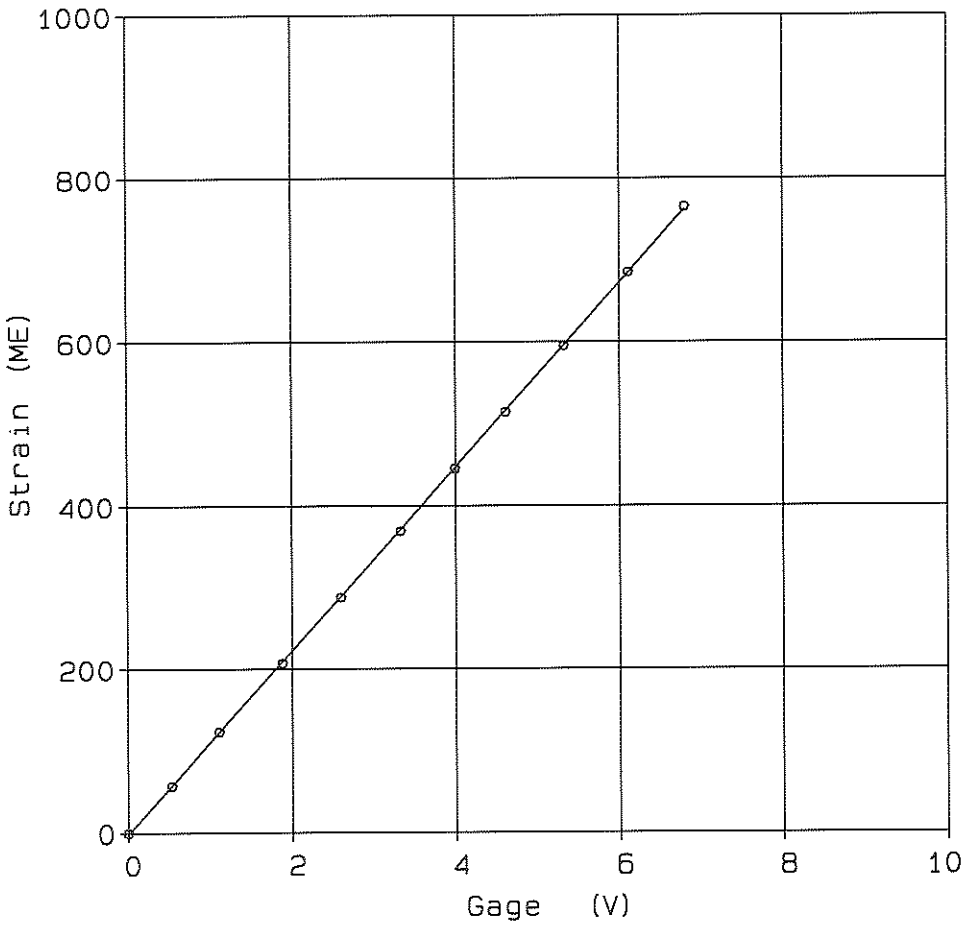

PDA Cal Factor = 112.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 390.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
58	.53
124	1.12
208	1.88
288	2.60
370	3.33
445	4.00
515	4.61
596	5.32
686	6.12
765	6.81

Calibrated by: Jim Deutsch

Calibrated on: 29-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2