
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 255W

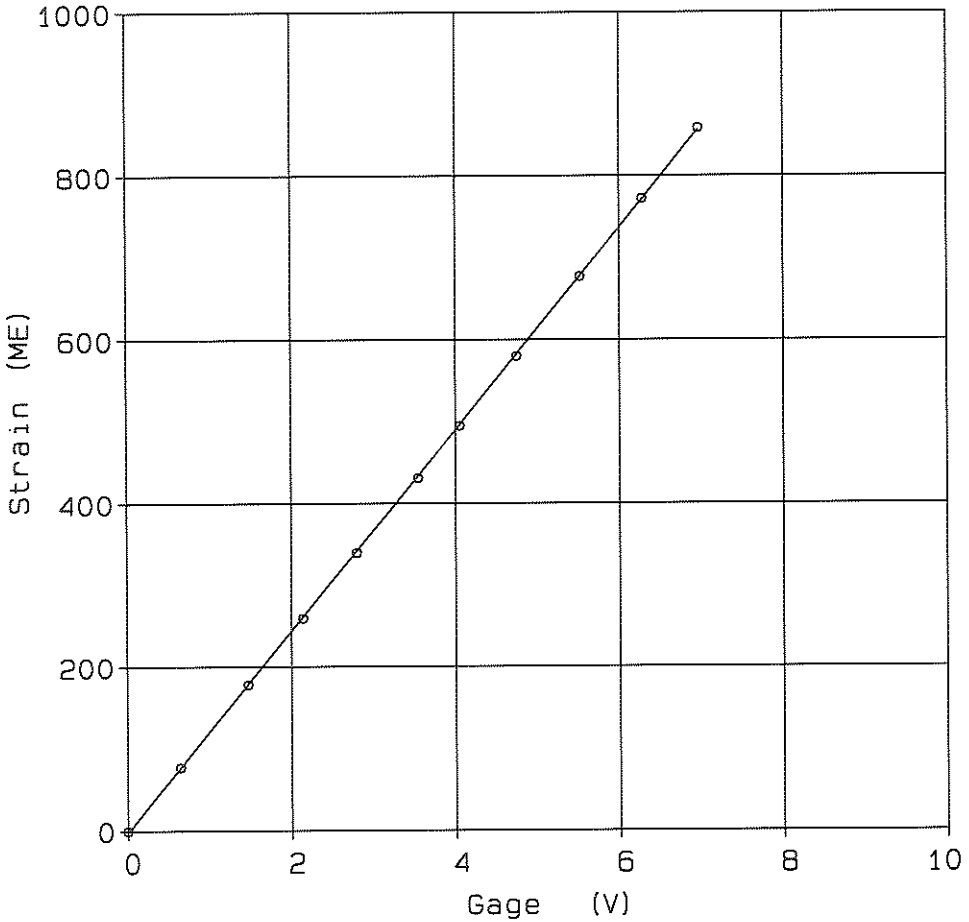

PDA Cal Factor = 123.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 427.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.64
178	1.47
260	2.15
340	2.79
432	3.54
495	4.06
581	4.75
677	5.53
772	6.28
858	6.98

Calibrated by: Jim Dunlop

Calibrated on: 29-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2