Pile Dynamics Inc
Transducer 256I

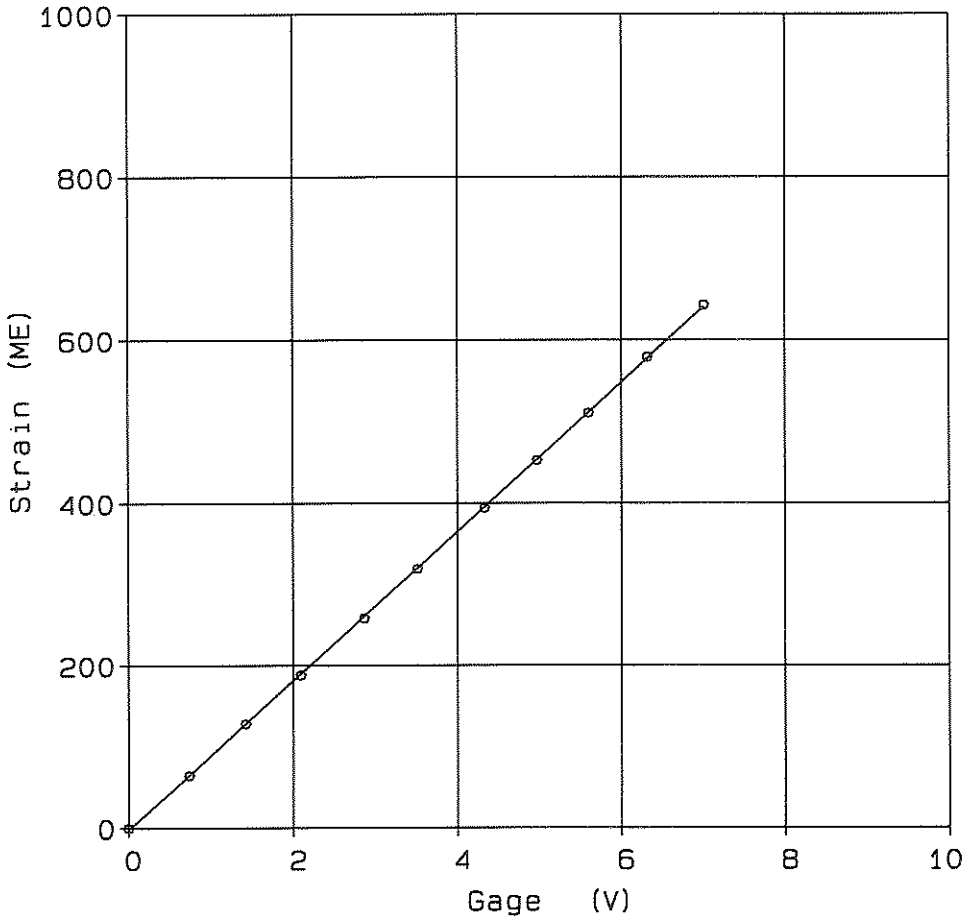

PDA Cal Factor = 91.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 318.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
66	.74
128	1.42
189	2.09
259	2.86
320	3.52
394	4.33
454	4.98
512	5.61
580	6.33
644	7.02

Calibrated by: _____

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2