
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 256W

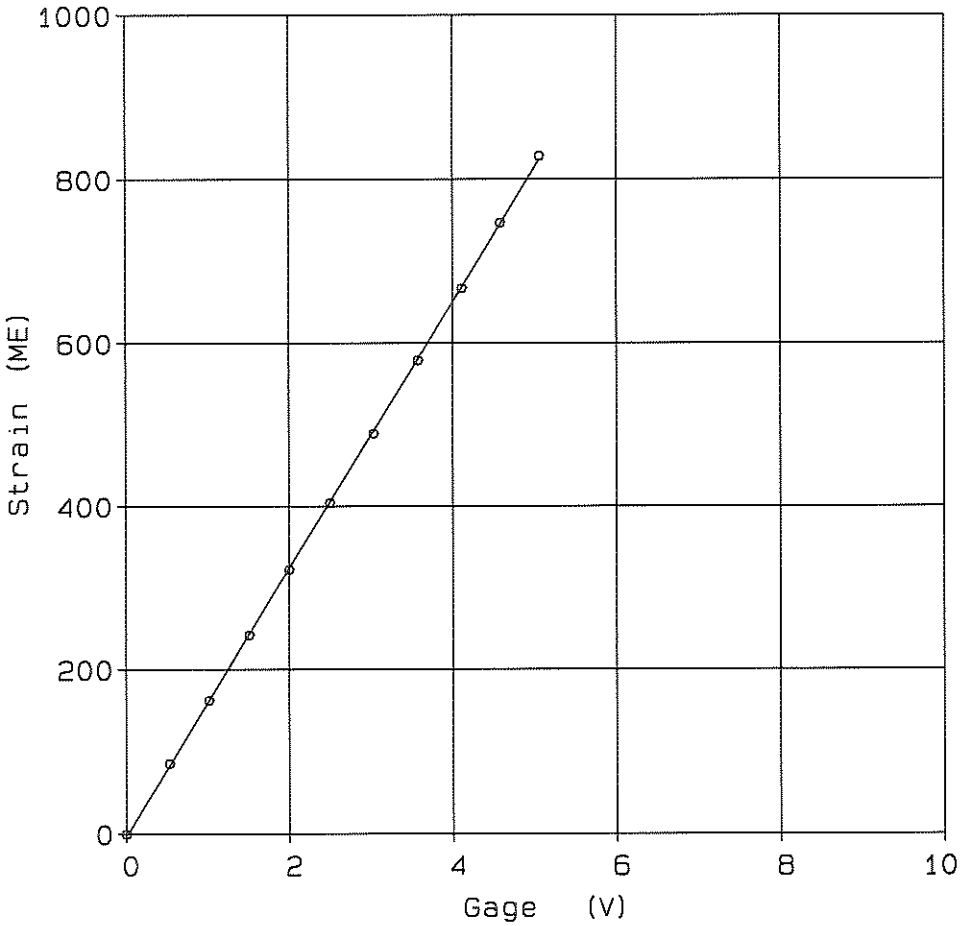

PDA Cal Factor = 163.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 567.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
86	.54
162	1.01
243	1.51
322	2.00
404	2.51
490	3.03
579	3.57
668	4.11
748	4.58
829	5.06

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2