Pile Dynamics Inc
Transducer 257I

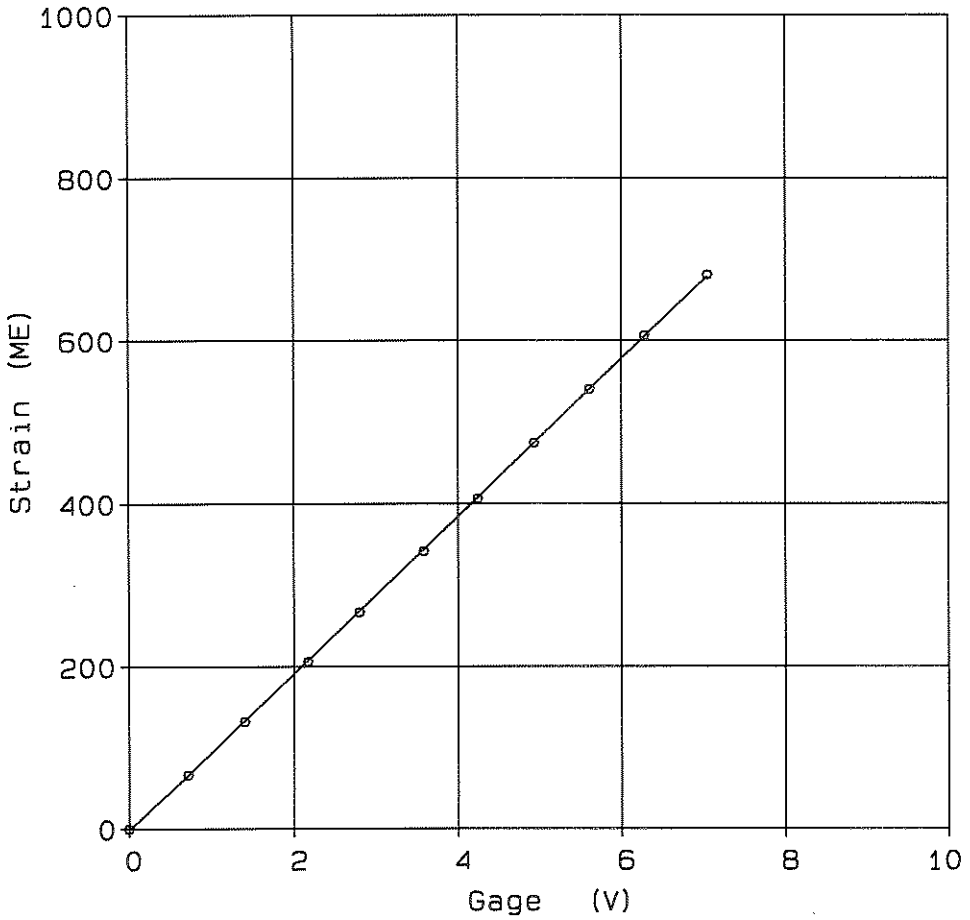

PDA Cal Factor = 96.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 335.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.71
133	1.40
207	2.17
268	2.81
342	3.58
407	4.25
474	4.94
540	5.61
606	6.29
682	7.06

Calibrated by: _____

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2