
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 257W

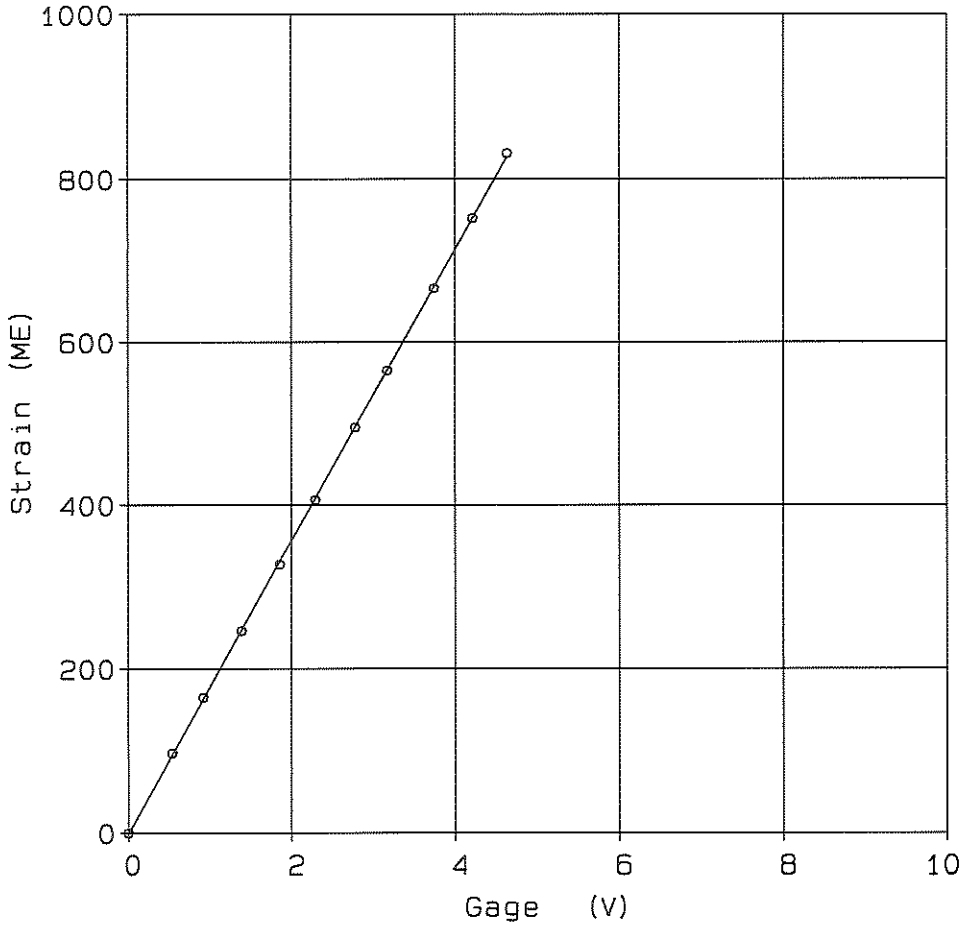

PDA Cal Factor = 178.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 621.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
97	.54
166	.93
246	1.40
328	1.87
406	2.30
495	2.78
565	3.18
667	3.74
753	4.21
831	4.64

Calibrated by: Jim Sanderson

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2