Pile Dynamics Inc
Transducer 258I

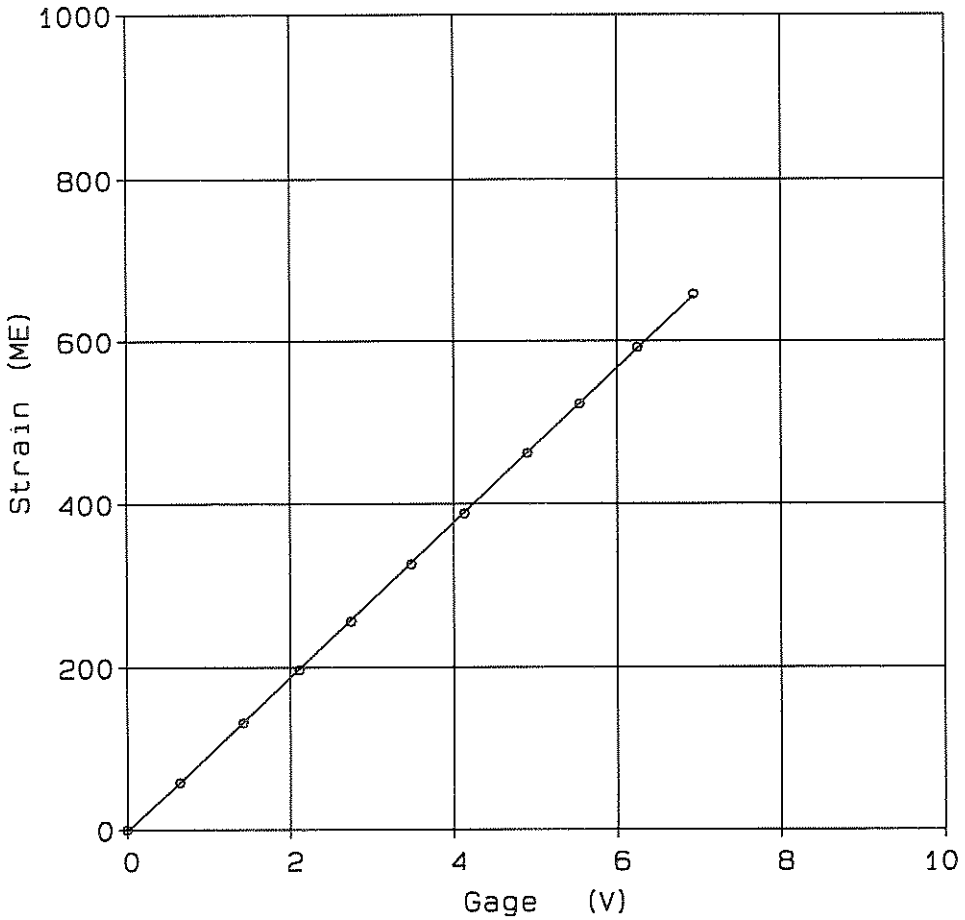

PDA Cal Factor = 94.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 329.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
59	.64
133	1.43
198	2.12
257	2.75
327	3.49
389	4.14
463	4.91
523	5.54
592	6.26
658	6.94

Calibrated by: Jason M Dahl

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2