
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 258W

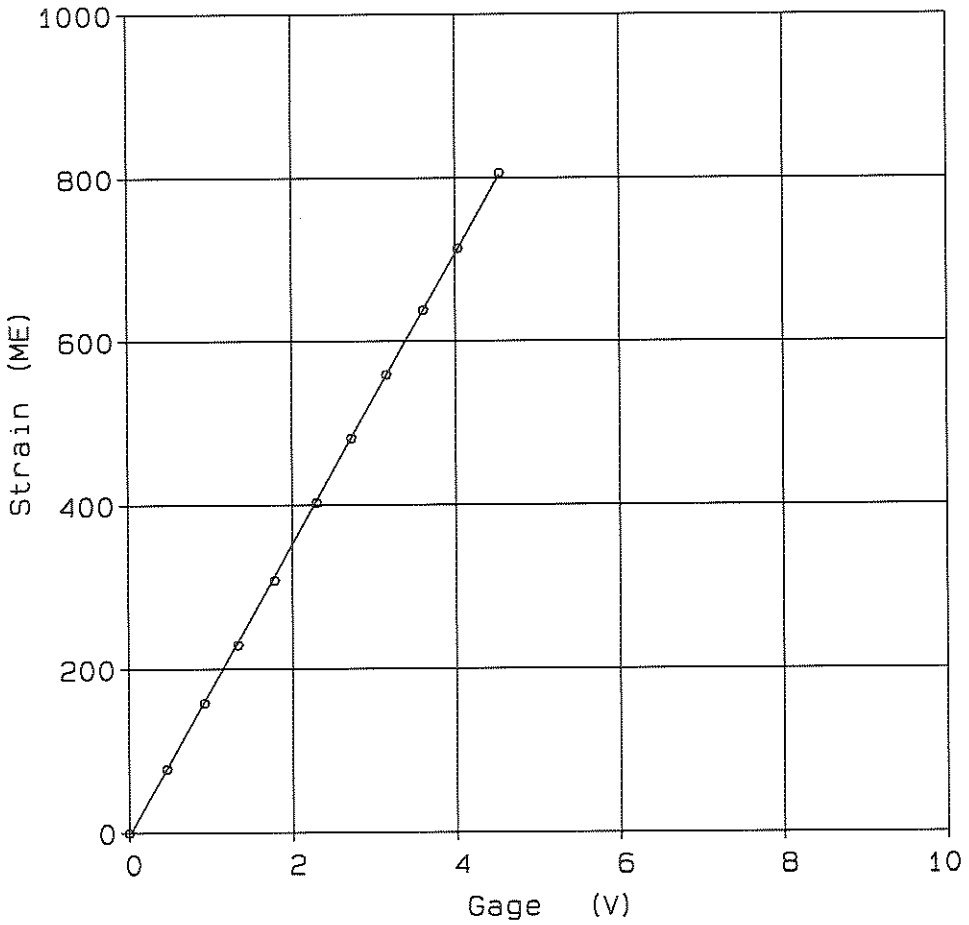

PDA Cal Factor = 178.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 618.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
79	.46
158	.92
230	1.33
309	1.78
404	2.30
481	2.73
560	3.16
638	3.61
715	4.03
806	4.54

Calibrated by: Jim Dimitriadis

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2