
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 259W

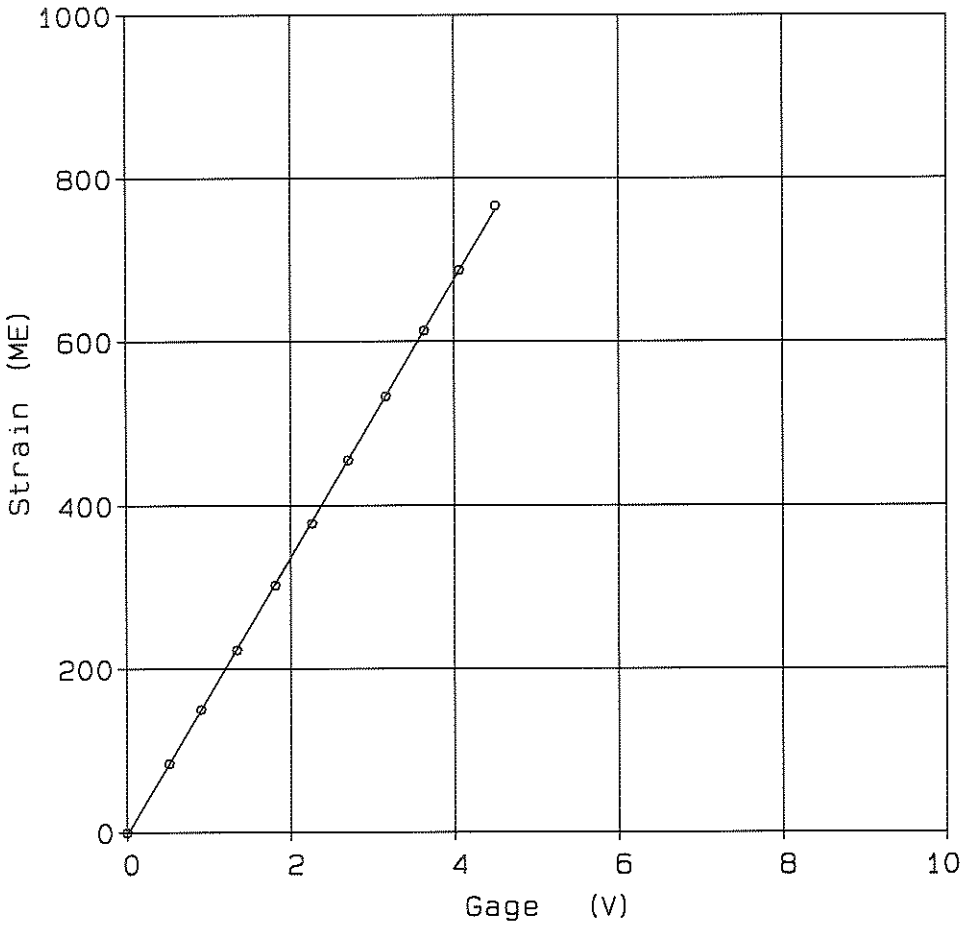

PDA Cal Factor = 170.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 590.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
85	.51
151	.91
223	1.34
303	1.81
378	2.27
455	2.71
534	3.17
614	3.64
688	4.06
766	4.50

Calibrated by: Jim Dunlap

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2