Pile Dynamics, Inc.
Transducer 260W

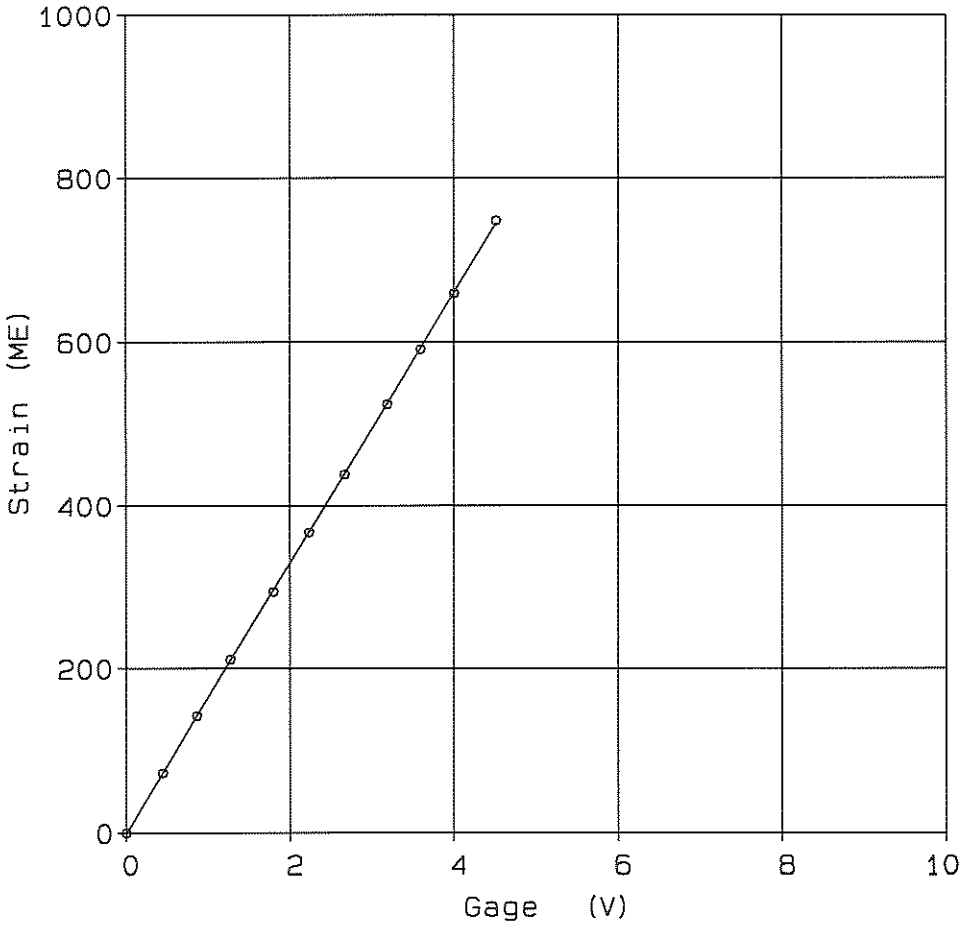

PDA Cal Factor = 165.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 574.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
73	.45
142	.87
211	1.29
295	1.80
368	2.24
438	2.66
524	3.19
591	3.59
659	4.00
749	4.52

Calibrated by: Jim Dentrabadoff

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2