Pile Dynamics, Inc.
Transducer 261W

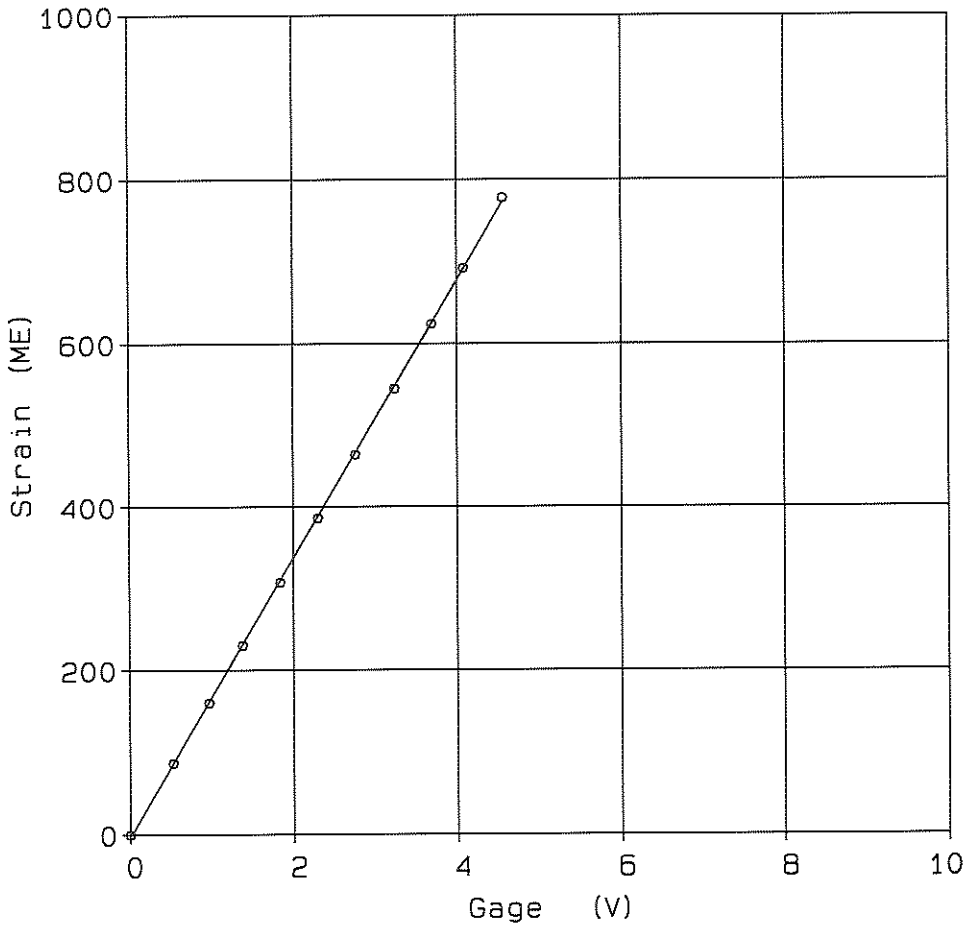

PDA Cal Factor = 170.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 591.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
87	.54
161	.98
231	1.39
308	1.84
386	2.30
465	2.76
546	3.24
624	3.70
692	4.09
778	4.57

Calibrated by: Jim Dorteland

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2