Pile Dynamics Inc
Transducer 262I

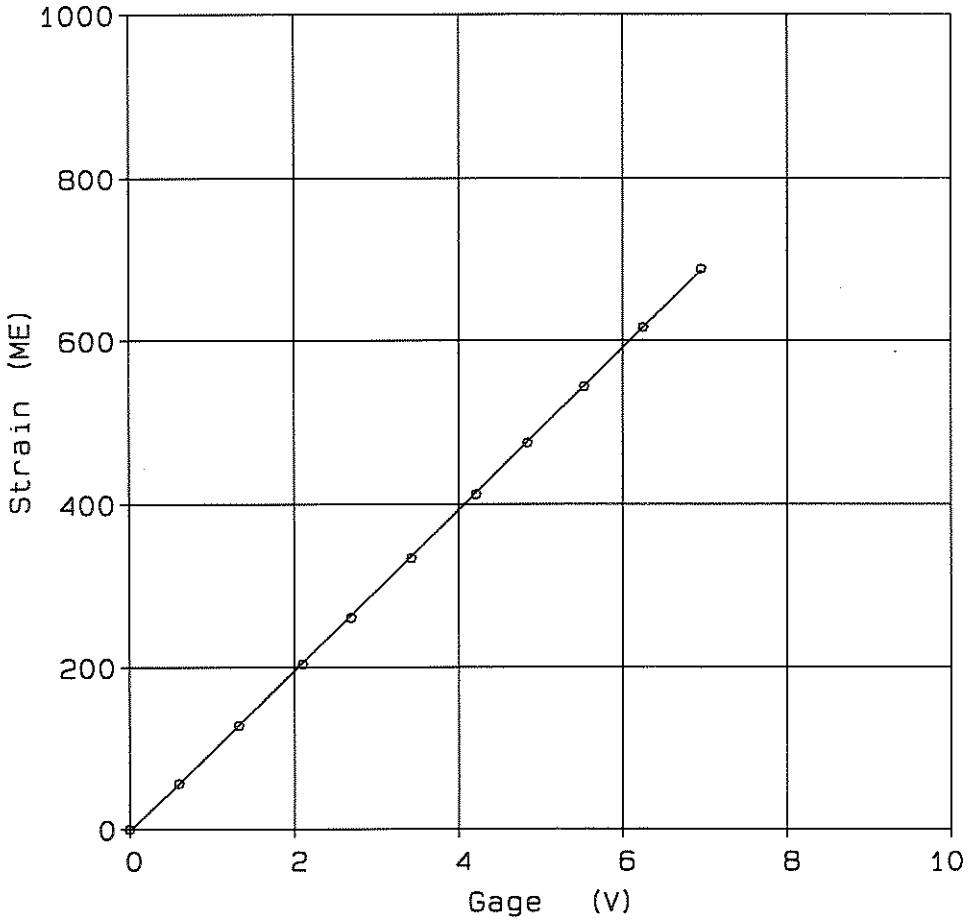

PDA Cal Factor	=	98.8 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	343.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
58	.60
129	1.32
205	2.11
262	2.69
335	3.43
413	4.21
476	4.84
544	5.53
617	6.26
689	6.97

Calibrated by: Jason M Gold

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2