
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 262W

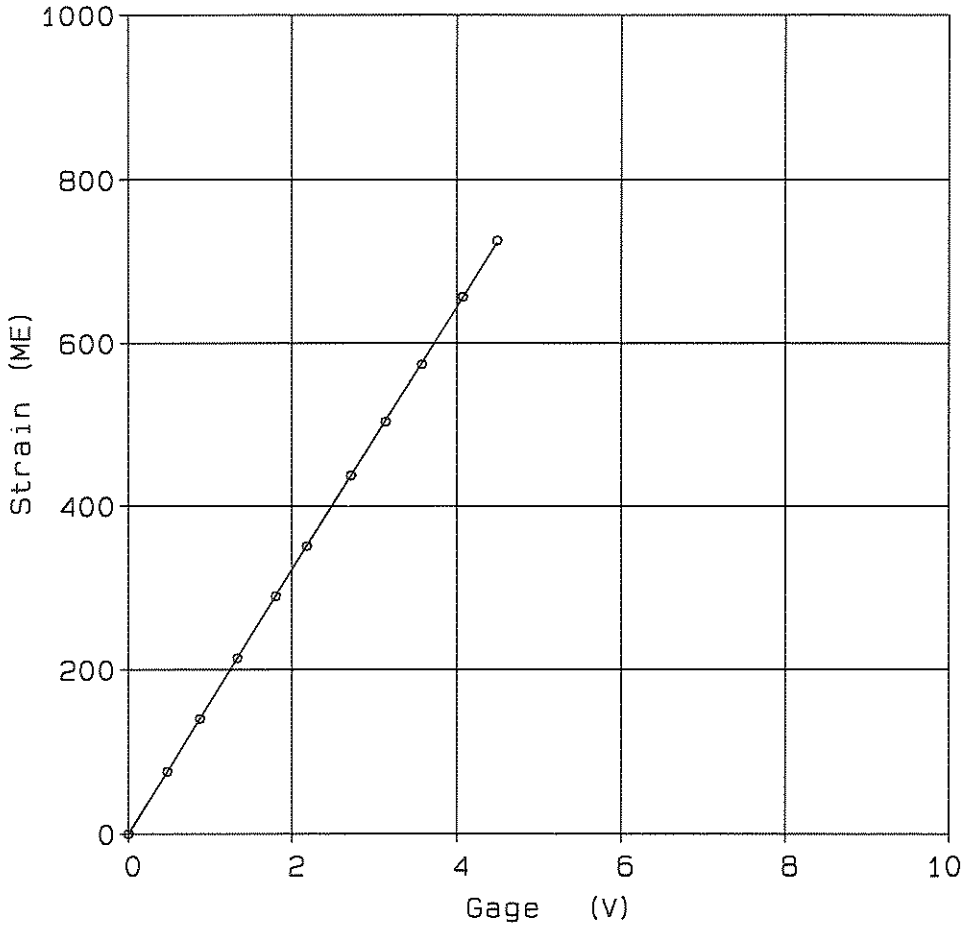

PDA Cal Factor	=	161.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	560.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.48
141	.87
215	1.33
290	1.80
351	2.19
437	2.72
503	3.13
575	3.57
657	4.08
727	4.49

Calibrated by: Jim Deutschendorf

Calibrated on: 01-Feb-95