
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 263W

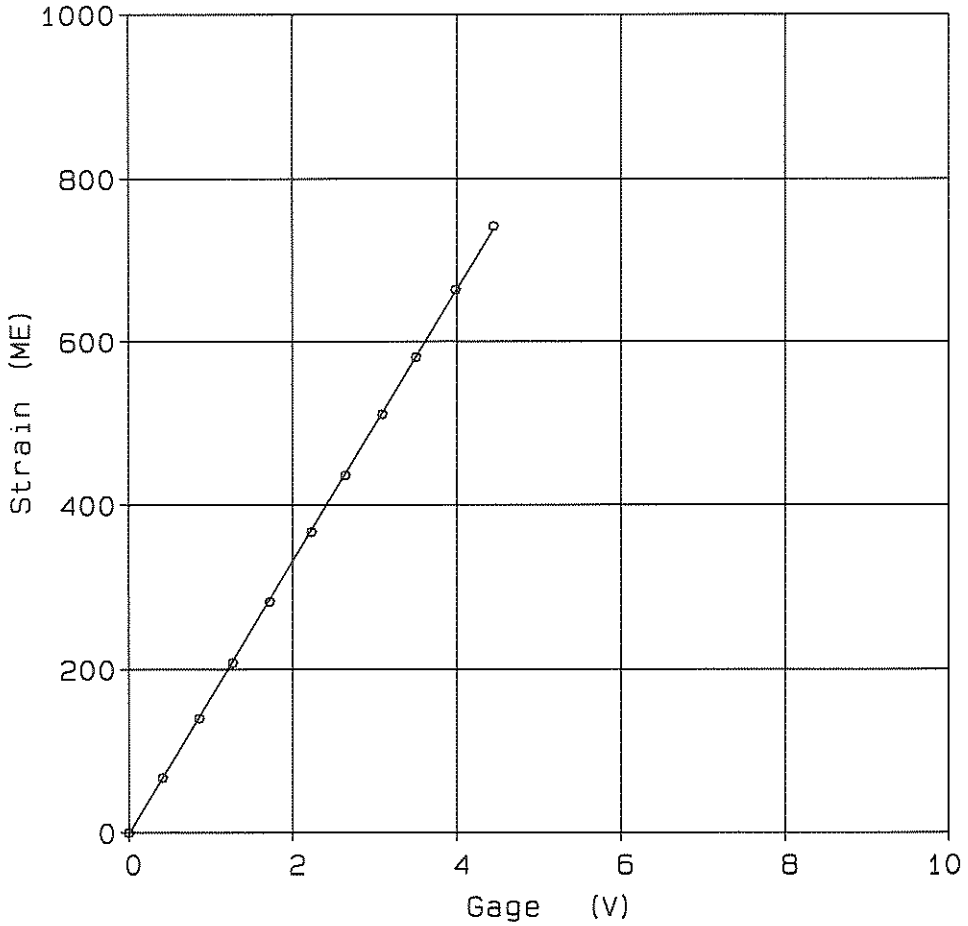

PDA Cal Factor = 166.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 579.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.42
141	.86
209	1.28
283	1.72
367	2.23
436	2.65
512	3.09
582	3.51
664	3.99
742	4.45

Calibrated by: Jim Stenkruff

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2