
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 264W

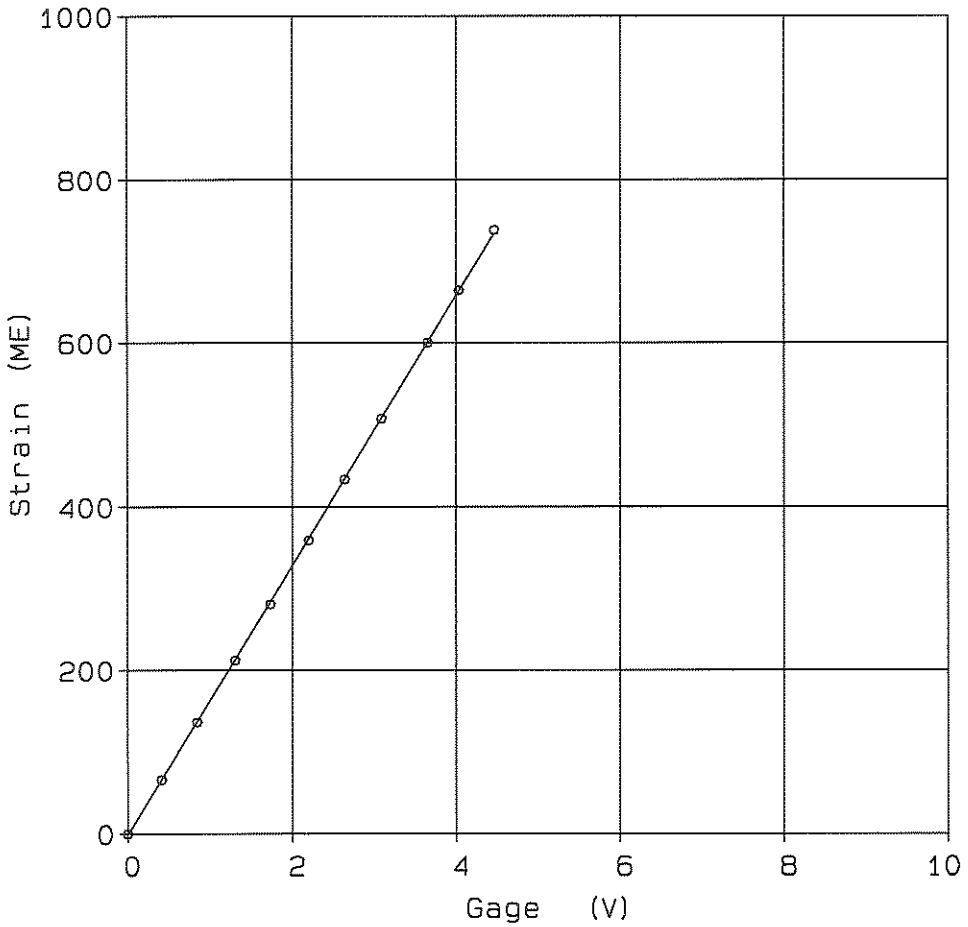

PDA Cal Factor = 165.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 573.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.42
137	.84
213	1.31
282	1.74
359	2.20
433	2.65
508	3.10
601	3.65
664	4.04
738	4.46

Calibrated by: Jim Dorthchuff

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2